

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCEGO:

ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

**DOSTAWA ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ DWÓCH
ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW
BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH
ORAZ AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PRZEDANALITYCZNEGO.
PN-13/26**

PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r.
– PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz.U.2024.1320 ze zm.)



tel. 91 42 51 410 / fax: 91 42 51 406



szpital@onkologia.szczecin.pl



www.onkologia.szczecin.pl

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Nazwa oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin.
2. Numer telefonu: sekretariat – 91 42 51 409.
3. Adres poczty elektronicznej: szpital@onkologia.szczecin.pl
4. Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu publicznym Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: **31.03.2026 r.**
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1287417>

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Dokumenty prowadzonego postępowania, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1287417>

<https://zcoszczecin.bip.gov.pl/search/publiccontracts/>

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 i 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne określone na podstawie art. 3 ww. Ustawy.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunków udziału w postępowaniu.

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizacyjnego**, szczegółowo określonego w **Załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do niniejszej SWZ, tj.:**
 - 1) Szczegółowy opis systemu biochemiczno – immunochemicznego – **Załącznik nr 1 do SWZ,**
 - 2) Szczegółowy opis systemu przedanalizacyjnego – **Załącznik nr 2 do SWZ,**
 - 3) Ocena parametrów systemu biochemiczno – immunochemicznego, odczynników biochemicznych i immunochemicznych – **Załącznik nr 3 do SWZ,**
 - 4) Rzut pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji systemu biochemiczno – immunochemicznego i stacji wody, czyli 2 aparatów, 2 stacji wody oraz sortera. W tym zawarcie dokumentacji technicznej elektrycznej i sieciowej – **Załącznik nr 4 do SWZ,**

- 5) Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia – ceny jednostkowe – **Załącznik nr 5 do SWZ.**
2. Miejscem dostawy jest Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZAMAWIAJĄCEGO w Szczecinie, przy ul. Strzałowskiej 22 w budynku **Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów** (dojazd od ulicy Rolnej).
3. CPV przedmiotu zamówienia:
- 1) 33696500-0 odczynniki laboratoryjne,
 - 2) 38434500-1 analizatory biochemiczne,
 - 3) 38434580-5 analizatory testów immunologicznych,
 - 4) 38000000-5 aparatura kontrolna i badawcza.
4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi, oprócz dostawy i dzierżawy, ustawienie, montaż urządzeń wraz z ewentualnym doprowadzeniem wymaganych mediów, ich uruchomienie, podłączenie do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap oraz przeszkolenie personelu (użytkowników i administratorów).
5. Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 Ustawy.
6. System biochemiczno – immunochemiczny – informacje na temat mediów – opis istniejących instalacji:
- 6.1. Instalacja prądowa: do obecnych urządzeń systemu biochemiczno-immunochemicznego doprowadzone są dwa obwody elektryczne, wyprowadzone z piętrowej rozdzielni elektrycznej kablami YDYżo 3x4mm², zakończone gniazdami 32 A. Zabezpieczenie każdego z obwodów – zabezpieczenie różnicowo-nadprądowe P301 C 32 A. Zasilanie obwodów elektrycznych rezerwowane jest agregatem prądotwórczym. W przypadku zaniku napięcia z zawodowej sieci energetycznej, w przeciągu 60 s zostanie podane napięcie z agregatu prądotwórczego.
- Zasilanie stacji uzdatniania wody: obecne stacje uzdatniania wody podłączone są do istniejących gniazd elektrycznych. Obwód elektryczny jest zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym P312 B16 30 mA. Do obwodu obecnie są podłączone następujące urządzenia: lodówka o mocy 1550 VA; dwie stacje uzdatniania wody o mocy 900 VA. Zasilanie obwodu elektrycznego rezerwowane jest agregatem prądotwórczym. W przypadku zaniku napięcia z zawodowej sieci energetycznej, w przeciągu 60 s zostanie podane napięcie z agregatu prądotwórczego.
- 6.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna: w pomieszczeniu, w którym przewidziany jest montaż stacji wody (**Załącznik nr 4 do SWZ** przedstawia rzut pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji systemu biochemiczno – immunochemicznego i stacji wody), znajduje się przyłącze wody zimnej, zakończone zaworem odcinającym ½ cala. Instalacja kanalizacyjna zakończona jest ściennym odpływem Ø50 mm. Pomiędzy pomieszczeniem L7 i L8 znajduje się obecnie wykorzystywana instalacja przyłączeniowa wody uzdatnionej, składająca się z dwóch rur PEX fi zew. 20,2 mm. W przypadku konieczności rozbudowy instalacji, rozbudowa leży w gestii WYKONAWCY.
- 6.3 Instalacja sieciowa (pasywna) – wymagania dotyczące nowej instalacji niskoprądowej zgodnie z **Załącznikiem technicznym nr 1 do SWZ**. ZAMAWIAJĄCY wymaga, aby ilość dostępnych gniazd sieciowych była równa ilości gniazd sieciowych wymaganych fizycznie przez aparaty – nawet w przypadku konieczności wykorzystania urządzenia pośredniczącego, tworzącego sieć wewnętrzną dostawcy, która to nie jest wskazana do zastosowania w infrastrukturze ZAMAWIAJĄCEGO. Wskazana jest wizja lokalna. Okablowanie niskoprądowe prowadzone od gniazda do aparatu

nie może być układane przy użyciu opasek uciskowych, wykorzystane mają zostać rzepy. Opis aktualnego stanu pomieszczeń oraz wymagań poniżej:

1) dotyczy **Załącznika nr 1 do SWZ** – systemu biochemiczno – immunochemicznego:

- a) miejsce instalacji systemu: pomieszczenie L8 – pracownia biochemii,
- b) pomieszczenie jest wewnętrznie podzielone ścianką na dwa pomniejsze pomieszczenia,
- c) w części pomieszczenia od strony rejestracji po odłączeniu bieżącego aparatu będzie dostępne jedynie to jedno gniazdo sieciowe,
- d) w części pomieszczenia od strony kierownika laboratorium po odłączeniu bieżącego aparatu będzie dostępne zwolnione gniazdo sieciowe oraz jedno dodatkowe.
- e) w przypadku braku dostępnych wolnych gniazd sieciowych wymaganych do uruchomienia urządzenia, wymagane jest należy wykonać dodatkową instalację niskoprądową – dodatkowe gniazda należy umieścić w okolicy (+/- 10 cm) istniejących gniazdek, chyba że ZAMAWIAJĄCY zaakceptuje pisemnie inne miejsce instalacji. Wymagania **Załącznik techniczny nr 1 do SWZ**.

2) dotyczy **Załącznika nr 2 do SWZ** – system przedanalizycznego:

- a) miejsce instalacji systemu: pomieszczenie L22 – pomieszczenie przygotowania materiału,
- b) w pomieszczeniu nie ma dostępnych gniazd sieciowych do połączenia urządzenia, należy wykonać instalację niskoprądową, zgodnie z wymaganiami z **Załącznika technicznego nr 1 do SWZ**,
- c) ilość wymaganych gniazd do wykonania równa jest ilości wymaganych gniazd przez dostarczane urządzenia do pomieszczenia, zaokrąglona w górę do liczby parzystej, powiększona o 2 zapasowe gniazda sieciowe,
- d) strony ustalają, że całkowita liczba gniazd sieciowych (punktów) wyniesie n , zgodnie z wymaganiami aparatów oraz zachowaniem wymaganego przez ZAMAWIAJĄCEGO zapasu, WYKONAWCA podzieli prace na dwa równe podziały, po $n/2$ punktów w każdym, zgodnie z zatwierdzonym, wcześniej przedstawionym ZAMAWIAJĄCEMU schematem instalacji, każdy punkt dostępowy musi składać się z kompletu 2xRJ45, przy założeniu, iż każde z ustalonych miejsc ma znajdować się na innej ścianie, przy zachowaniu odstępu między punktami w poziomie, minimum 5 m licząc od pionu montażu pierwszego z punktów do pionu montażu drugiego z punktów.

7. Klauzula równoważności:

W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjąć należy, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Ustawy, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, i przyjąć należy, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany "z nazwy" przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie

przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o nie gorszych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w opisie przedmiotu zamówienia. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć, jakości osiąganych wyników ani negatywnie wpłynąć na prawidłowe użytkowanie lub funkcjonowanie produktu lub usługi zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ w ofercie produktów/ usług równoważnych do produktów/ usług wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO.

8. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne obowiązującymi przepisami, w tym z Ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2024 poz. 1620 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG – w zakresie wyrobów medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

VI. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA.

ZAMAWIAJĄCY określił szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia w **Załącznikach nr 1, 2, 3 do SWZ.**

VII. FINANSOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

1. Oferowana cena w ofercie ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Rozliczenie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w złotych polskich.
3. Termin płatności wynosi do od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU.
4. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty, w formie przelewu na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze.
5. Szczegółowe koszty jednostkowe przedmiotu zamówienia określone zostaną przez WYKONAWCĘ w **Załączniku nr 5 do SWZ.**
6. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Przedmiot zamówienia, w tym dzierżawa analizatorów, będzie realizowany do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 pkt. 1) odnoszącej się do dostawy odczynników i ich zużycia odczynników przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłużej jednak niż **48 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy przez dwie strony** przy czym:

- 1) dostarczenie i uruchomienie **pierwszego analizatora zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego** nastąpi **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy**,
 - a. analizator należy uruchomić i podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap - integracja dwukierunkowa (na wzór integracji obecnej, zgodnie z wytycznymi dostawcy HIS, wraz z aktualnie zleconą

- integracją sortera, koszty wykonania integracji znajdują się po stronie WYKONAWCY) (integrację WYKONAWCA ma zlecić **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy** i poinformować o tym Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO,
- b. **14 dni kalendarzowych przed dostarczeniem urządzeń** (w przypadku kilku dostaw należy procedurę powtórzyć dla każdej z dostaw osobno) poinformować Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji o dostawie,
 - c. **7 dni kalendarzowych przed dostawą** potwierdzić w Dziale Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji termin instalacji urządzeń,
 - d. przeszkolić personel ZAMAWIAJĄCEGO zakończony protokołem ze szkolenia,
- 2) dostarczenie i uruchomienie **drugiego analizatora zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego** nastąpi **do 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy**,
- a. analizator należy uruchomić i podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap - integracja dwukierunkowa (na wzór integracji obecnej, zgodnie z wytycznymi dostawcy HIS, wraz z aktualnie zleconą integracją sortera, koszty wykonania integracji znajdują się po stronie WYKONAWCY) (integrację WYKONAWCA ma zlecić **do 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy** i poinformować o tym Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO,
 - b. **14 dni kalendarzowych przed dostarczeniem urządzeń** (w przypadku kilku dostaw należy procedurę powtórzyć dla każdej z dostaw osobno) poinformować Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji o dostawie,
 - c. **7 dni kalendarzowych przed dostawą** potwierdzić w Dziale Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji termin instalacji urządzeń,
 - d. przeszkolić personel ZAMAWIAJĄCEGO zakończony protokołem ze szkolenia,
- 3) dostarczenie i uruchomienie **automatycznego systemu przedanalizacyjnego** nastąpi **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy**,
- a. system należy uruchomić i podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap - integracja dwukierunkowa (na wzór integracji obecnej, zgodnie z wytycznymi dostawcy HIS, wraz z aktualnie zleconą integracją sortera, koszty wykonania integracji znajdują się po stronie WYKONAWCY) (integrację WYKONAWCA ma zlecić **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy** i poinformować o tym Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO,
 - b. **14 dni kalendarzowych przed dostarczeniem urządzeń** (w przypadku kilku dostaw należy procedurę powtórzyć dla każdej z dostaw osobno) poinformować Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji o dostawie,
 - c. **7 dni kalendarzowych przed dostawą** potwierdzić w Dziale Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji termin instalacji urządzeń,
 - d. przeszkolić personel ZAMAWIAJĄCEGO zakończony protokołem ze szkolenia,
- 4) pierwsza dostawa odczynników nastąpi wraz z uruchomieniem **pierwszego analizatora** zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, zgodnie z zamówieniem ZAMAWIAJĄCEGO, złożonym w dniu podpisania umowy.

Przyczyną wskazania konkretnych terminów w punktach 1) – 3) są terminy obowiązywania dotychczasowej umowy i konieczność zapewnienia ciągłości pracy

Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji.

IX. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU DO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dzielenie zamówienia nie jest celowe ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na konieczność zachowania kompleksowości jego realizacji i spójności wszystkich elementów. Podział na części i konieczność skoordynowania różnych WYKONAWCÓW mógłby zwiększać koszty serwisu, a nadto utrudnić ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych WYKONAWCÓW.

X. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH / DODATKOWYCH.

ZAMAWIAJĄCY **nie przewiduje** w ogłoszeniu o zamówieniu udzielenia zamówień na dostawę dodatkowe, o których mowa w art. 214 ust. 1, pkt 8 Ustawy.

XI. INFORMACJE O DOPUSZCZENIU OFERT WARIANTOWYCH ORAZ WARUNKACH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ.

ZAMAWIAJĄCY **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

XII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w **Załączniku nr 6 do SWZ**.

XIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCAMI odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, która jest dostępna pod adresem <https://platformazakupowa.pl/>.
2. **Identyfikator (ID) postępowania na Platformie Zakupowej: 1287417**
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy Zakupowej (przycisk „wszystkie postępowania”).
4. ZAMAWIAJĄCY informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla WYKONAWCÓW” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
5. WYKONAWCA, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](#) w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,

- b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosek dostępnej [pod linkiem](#).
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej ani logowania.
7. Komunikacja między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCAMI odbywać się będzie poprzez Platformę Zakupową w szczególności w poniższym zakresie:
- a. przesyłania ZAMAWIAJĄCEMU wniosków o wyjaśnianie treści SWZ,
 - b. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
 - c. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia/ poprawienia/ uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 - d. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
 - e. przesyłania odpowiedzi na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych,
 - f. przesyłania odpowiedzi na inne wezwania ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 - g. przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń WYKONAWCY.
8. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do ZAMAWIAJĄCEGO. Nie dotyczy składania ofert.
9. Uwaga! WYKONAWCA niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość do ZAMAWIAJĄCEGO”, po kliknięciu przycisku **Wyślij**, otrzyma na adres mailowy, podany w polu **Twój adres e-mail**, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu **Kod Uwierzytelniający**, a następnie potwierdzić przyciskiem **Wyślij**. Następnie WYKONAWCA otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez 30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.
10. ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCOM informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z niniejszym postępowaniem, odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, informacje, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, ZAMAWIAJĄCY będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny WYKONAWCA, będzie przekazywana do tego wykonawcy, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w wiadomości prywatnej.
11. WYKONAWCA jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
12. **ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy ZAMAWIAJĄCY zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość

do ZAMAWIAJĄCEGO"). Taka oferta zostanie uznana przez ZAMAWIAJĄCEGO za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

13. ZAMAWIAJĄCY określa sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania). Dokumenty muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452, dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów).
14. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów informatycznych (Dz.U. 2024 poz. 773), dalej: rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 Ustawy PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
15. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
 - a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
 - b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. w treści wiadomości e-mail.
16. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2026.85 t.j.) WYKONAWCA, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem Platformy Zakupowej, ZAMAWIAJĄCY dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl (nie dotyczy składania ofert).
18. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje komunikowania się z WYKONAWCAMI w inny sposób niż przy użyciu ww. środków komunikacji elektronicznej.

XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKREŚLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66 I ART. 69

ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje sposobu komunikacji w inny sposób, niż określony w rozdziale XIII.

XV. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
 - a) odczynniki, materiały zużywalne: **Teresa Zielińska – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, e-mail: tzielinska@onkologia.szczecin.pl, nr tel.: 91 42 51 531,**
 - b) dzierżawa przedmiotu zamówienia: **Dział urządzeń i gazów medycznych, e-mail: aparatura@onkologia.szczecin.pl, nr tel.: 91 42 51 443,**
 - c) integracja dzierżawionego przedmiotu zamówienia z systemem szpitalnym ESKULAP: **Wojciech Gądzikiewicz – Kierownik Działu IT, email: wgadzikiewicz@onkologia.szczecin.pl, nr tel.: 91 42 51 599.**
2. w sprawach formalnych dotyczących zamówienia publicznego: **Marta Krysiak – Specjalista ds. zamówień publicznych, nr tel.: 91 42 51 431.**

Adres e-mail do kontaktu: zamowienia_publiczne@onkologia.szczecin.pl

XVI. WADIUM.

ZAMAWIAJĄCY **nie wymaga** wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. WYKONAWCA związany jest ofertą od dnia upływu składania ofert **do dnia 03.08.2026 r.**
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w punkcie 1, ZAMAWIAJĄCY przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2, wymaga złożenia przez WYKONAWCĘ pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XVIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA.

1. ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy:
 - 1) podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy,
 - 2) w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami, których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, to jest na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
2. WYKONAWCA może zostać wykluczony przez ZAMAWIAJĄCEGO na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 3 Ustawy.
4. Wykluczenie WYKONAWCY następuje na okres wskazany w art. 111 Ustawy.

5. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
- 1) WYKONAWCĘ oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
 - 2) WYKONAWCĘ oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz.644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3,
 - 3) WYKONAWCĘ oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
- Ww. wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1 art. 7 ww. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
6. Wykluczenie z postępowania następuje również na podstawie - art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022) wraz z dalszymi jego zmianami.
7. ZAMAWIAJĄCY przypomina, że zgodnie z art. 5k ww. rozporządzenia zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
- a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu lub,
 - c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim. Oferowane ceny winny być wyrażone w złotych polskich.
2. Ofertę, pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2026 r., poz. 85), w celu utrzymania w poufności tych informacji, WYKONAWCA przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. WYKONAWCA zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez WYKONAWCĘ tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez ZAMAWIAJĄCEGO, jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez WYKONAWCĘ podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.
4. Do oferty należy dołączyć w formie elektronicznej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy).
5. Do przygotowania oferty należy wykorzystać **formularz ofertowy (Załącznik nr 7 do SWZ)**.
6. Do oferty należy dołączyć:
 - 6.1. **Pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji WYKONAWCY**, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG). Powyższe dotyczy także WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 - 6.2. **Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu WYKONAWCY jest umocowana do jego reprezentowania. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli ZAMAWIAJĄCY może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile WYKONAWCA wskaże w formularzu oferty dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. NIP, nr KRS). Powyższe dotyczy także WYKONAWCÓW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
 - 6.3. Wypełniony **Załącznik nr 1 do SWZ** - Szczegółowy opis systemu biochemiczno-immunochemicznego.

Brak dołączenia do oferty ww. załącznika spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.
 - 6.4. Wypełniony **Załącznik nr 2 do SWZ** - Szczegółowy opis systemu przedanalizycznego.

Brak dołączenia do oferty ww. załącznika spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.

- 6.5. Wypełniony **Załącznik nr 3 do SWZ** – Ocena parametrów systemu biochemiczno-immunochemicznego, odczynników biochemicznych i immunochemicznych.

Brak dołączenia do oferty ww. załącznika spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.

- 6.6. Wypełniony **Załącznik nr 5 do SWZ** – Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia.

Brak dołączenia do oferty ww. załącznika spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.

- 6.7. Wypełniony **Załącznik nr 7 do SWZ** – Formularz ofertowy.

Brak dołączenia do oferty ww. załącznika spowoduje odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP.

- 6.8. Oświadczenie, o którym mowa art. 125 ust. 1 Ustawy, to jest **oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu** z postępowania na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (**JEDZ** Przedmiotowe Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez ZAMAWIAJĄCEGO podmiotowe środki dowodowe.

Instrukcja wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej:
<https://www.gov.pl/web/uzp/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>

Uwaga:

- 1) ZAMAWIAJĄCY udostępnia WYKONAWCOM wygenerowany z serwisu eESPD plik xml JEDZ. Dane z utworzonego w ten sposób pliku xml WYKONAWCA może zaimportować celem stworzenia własnego dokumentu JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez ZAMAWIAJĄCEGO zawiera tylko pola przez niego wskazane niezbędne do wypełnienia. W przypadku gdy WYKONAWCA korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ (lub edytowalnej wersji formularza zamieszczonej na stornach Urzędu Zamówień Publicznych) aktywne są wszystkie pola formularza. ZAMAWIAJĄCY zaleca wypełnić JEDZ w zakresie wymaganym przez ZAMAWIAJĄCEGO do niniejszego postępowania i podpisać kwalifikowane podpisem elektronicznym. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisanie ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.
- 2) Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z WYKONAWCÓW.
- 3) Oświadczenie WYKONAWCY/ każdego z WYKONAWCÓW składających ofertę wspólną - o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte jest w podstawach wykluczenia o charakterze krajowym tj. w JEDZ w części III w pkt. D.
- 4) ZAMAWIAJĄCY zwraca uwagę, że w przekazanym w formacie xml. nie będzie znajdowała się informacja o rodzaju procedury (Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia/ Rodzaj procedury), gdyż narzędzie do wypełniania formularza nie zapisuje danych przygotowanych w tym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO (WYKONAWCA po zaimportowaniu pliku znajdzie w tym zakresie informację

„Nie określono”). Zaleca się aby WYKONAWCA wybrał z rozwijanej listy rodzaj procedury: „Procedura otwarta”. Ponadto ZAMAWIAJĄCY nie wymaga aby w formularzu JEDZ był wskazany numer ogłoszenia o zamówieniu.

- 6.9. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy (**Załącznik nr 8 do SWZ**) o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022) wraz z dalszymi jego zmianami

Uwaga:

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przedmiotowe oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy z WYKONAWCÓW.

7. ZAMAWIAJĄCY wymaga następujących **przedmiotowych środków dowodowych**, które należy załączyć do oferty:

- 7.1. Ważne i aktualne na dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP dla każdego oferowanego wyrobu medycznego (dotyczy oferowanych odczynników oraz dzierżawy przedmiotu zamówienia):

- deklarację producenta o zgodności z obowiązującymi dla danego produktu normami,
- ważny certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych dla danego wyrobu.

- 7.2. W celu potwierdzenia, że oferowane do dzierżawy system biochemiczno-immunochemiczny i automatyczny system przedanalizacyjny oraz oferowane do dostawy odczynniki do badań biochemicznych i immunochemicznych, odpowiadają wymaganiom określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY żąda przedłożenia:

- 7.2.1. Oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy i dzierżawy, zgodnie z zapisami zawartymi **w Załączniku nr 1, nr 2, nr 3 do SWZ. (Załącznik 8 a do SWZ).**

8. Przed wyborem najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia **podmiotowych środków dowodowych**, zgodnie z art. 126 ust. 1 Ustawy.

- 8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, WYKONAWCA przedkłada:

- 8.1.1. Odpis lub informację z **Krajowego Rejestru Sądowego** lub z **Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

Uwaga: dokumenty wskazane powyżej, muszą być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- 8.1.2. Oświadczenie WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (**Załącznik nr 9 do SWZ**), o którym mowa w art. 125 ust. 1

Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
- b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi WYKONAWCAMI porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

8.1.3. Oświadczenie WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 Ustawy **(Załącznik nr 10 do SWZ)**, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2025 r. poz. 1714), z innym WYKONAWCĄ, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego WYKONAWCY należącego do tej samej grupy kapitałowej.

8.1.4. Aktualne na dzień złożenia informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, i 2, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy w zakresie dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego.

Uwaga: dokumenty wskazane powyżej muszą być sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

8.1.5. Jeżeli WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 8.1.4., składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, a także art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

Uwaga: dokumenty powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

- w pkt 8.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Uwaga: dokumenty powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

8.1.6. Jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy

nie wydaje się dokumentów, o których mowa, w pkt. 8.1.1. i 8.1.4., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie WYKONAWCY, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym WYKONAWCA ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania WYKONAWCY lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.

9. Jeżeli WYKONAWCA niełoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, ZAMAWIAJĄCY wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
10. Postanowień ust. 9 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
11. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
12. Jeżeli WYKONAWCA niełożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.8 i 6.9 podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, ZAMAWIAJĄCY wzywa WYKONAWCĘ odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
 - 1) oferta WYKONAWCY podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub
 - 2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
13. ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.8 i 6.9 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
14. Jeżeli złożone przez WYKONAWCĘ oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.8 i 6.9, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez WYKONAWCĘ warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
15. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) wraz z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 1824) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

XX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA.

1. WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 2 oraz zgodnie z zapisami zawartymi **w rozdziale XIII**.
2. Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert (art. 135 ust. 2 Ustawy), ZAMAWIAJĄCY udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później **niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert**.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, ZAMAWIAJĄCY może zmienić treść specyfikacji.
5. Każda zmiana, wprowadzona przez ZAMAWIAJĄCEGO, stanie się częścią specyfikacji oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zmiana specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ZAMAWIAJĄCY przekaże zmianę ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
6. W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od WYKONAWCÓW dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści specyfikacji i przygotowanie oferty, ZAMAWIAJĄCY przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.
7. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO będą podlegały nowemu terminowi.

XXI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 06.05.2026 roku, do godz. 7:30**.
2. ZAMAWIAJĄCY odrzuci ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1287417>
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku "Złóż ofertę" i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
6. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
7. Oferta, oświadczenia, przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) oraz inne wymagane dokumenty składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty WYKONAWCA składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
8. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. ZAMAWIAJĄCY wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

9. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy PZP, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli WYKONAWCA, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. WYKONAWCA, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
11. Każdy z WYKONAWCÓW może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.
12. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść WYKONAWCA, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
13. Dokumenty i oświadczenia składane przez WYKONAWCĘ powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
14. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
15. Szczegółowa instrukcja dla WYKONAWCÓW dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

XXII. TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 06.05.2026 roku, o godz. 7:40.**
2. Otwarcie ofert jest niejawne.
3. ZAMAWIAJĄCY, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje o:
 - 4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, których oferty zostały otwarte,
 - 4.2. cenach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
6. ZAMAWIAJĄCY poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
7. W toku badania i oceny ofert ZAMAWIAJĄCY może żądać od WYKONAWCÓW wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 Ustawy).
8. ZAMAWIAJĄCY poprawia w ofercie:
 - 1) omyłki pisarskie,

- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym WYKONAWCĘ, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, o którym mowa w punkcie 8 podpunkt 3, ZAMAWIAJĄCY wyznacza WYKONAWCY odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XXIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

1. WYKONAWCA w przedstawionej ofercie winien zaoferować łączną cenę, kompletną, jednoznaczną, która będzie ceną ostateczną.
2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, w tym: transport, ubezpieczenie, opłaty wynikające z polskiego prawa celnego, podatkowego, koszty dzierżawy itp. WYKONAWCA winien uwzględnić w cenie oferty również wszystkie inne koszty jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu postępowania, także nie wymienione w zdaniu poprzedzającym, a które mają wpływ na cenę oferty
3. Jeżeli WYKONAWCA stosuje w swojej praktyce kupieckiej upusty cenowe, to proponując je ZAMAWIAJĄCEMU w ofercie, musi już uwzględnić je w ostatecznej cenie oferty.
4. WYKONAWCA podaje w **Formularzu ofertowym (Załącznik nr 7 do SWZ)** wartość całkowitą przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT), wynikająca z obliczeń wskazanych z treści **Załącznika nr 5 do SWZ** (Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia).
5. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
7. WYKONAWCA podaje w **Szczegółowej wycenie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SWZ)** stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Ustawy, w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy).
8. Rozliczenia między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ będą prowadzone w złotych polskich.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
10. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu ZAMAWIAJĄCY dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku WYKONAWCA ma obowiązek w ofercie:
 - 1) poinformowania ZAMAWIAJĄCEGO, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u ZAMAWIAJĄCEGO obowiązku podatkowego,

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym ZAMAWIAJĄCEGO, bez kwoty podatku,
- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą WYKONAWCY, będzie miała zastosowanie.

XXIV. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującymi kryteriami:

lp.	Kryterium	(waga punktowa)
1.	cena	60
2.	termin realizacji zamówienia (dostawa odczynników)	10
3.	parametry systemu biochemiczno-immunochemicznego	10
4.	parametry odczynników biochemicznych	10
5.	parametry odczynników immunochemicznych	10

- 1) Wartość **kryterium nr 1 – cena oferty** – obliczana będzie wg wzoru:

$$W_{k1} = \frac{\text{najniższa cena spośród oferowanych ofert (niepodlegająca odrzuceniu)} \times 60}{\text{cena oferty}}$$

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium nr 1 wynosi 60.

- 2) Wartość kryterium nr 2 – **termin realizacji zamówienia** – będzie ustalona według następującego wzoru:

$$W_{k2} = \text{punkty przyznane ofercie}$$

Ocena w zakresie kryterium nr 2 zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza ofertowego i złożonej w nim deklaracji WYKONAWCY w zakresie terminu realizacji zamówienia (**z zastrzeżeniem, iż maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze**).

Liczba przyznanych punktów:

- a) termin realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych – 10 pkt,
- b) termin realizacji zamówienia: do 3 dni roboczych – 5 pkt,
- c) termin realizacji zamówienia: do 4 dni roboczych – 0 pkt,

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium nr 2 wynosi 10.

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że brak określenia lub błędne określenie w formularzu ofertowym ww. kryterium (podanie innej wartości niż wskazana w pkt a - c powyżej lub wpisanie więcej niż jednej wartości spośród

wskazanych w pkt a - c powyżej) jest jednoznaczne z wyborem najdłuższego terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

- 3) Wartość kryterium nr 3 – **parametry systemu biochemiczno-immunochemicznego** – będzie ustalona według następującego wzoru:

$$W_{k3} = \frac{\text{liczba uzyskanych punktów}}{12} \times 10$$

Opis punktacji kryterium nr 3 zawiera **Załącznik nr 3 do SWZ**, punkt a).

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że brak dołączenia do oferty ww. załącznika lub też nieprawidłowe uzupełnienie ww. załącznika będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium nr 3 wynosi 10.

- 4) Wartość kryterium nr 4 – **parametry odczynników biochemicznych** – będzie ustalona według następującego wzoru:

$$W_{k3} = \frac{\text{liczba uzyskanych punktów}}{214} \times 10$$

Opis punktacji kryterium nr 4 zawiera **Załącznik nr 3 do SWZ**, punkt b).

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że brak dołączenia do oferty ww. załącznika lub też nieprawidłowe uzupełnienie ww. załącznika będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium nr 4 wynosi 10.

- 5) Wartość kryterium nr 5 – **parametry odczynników immunochemicznych** – będzie ustalona według następującego wzoru:

$$W_{k3} = \frac{\text{liczba uzyskanych punktów}}{105} \times 10$$

Opis punktacji kryterium nr 5 zawiera **Załącznik nr 3 do SWZ**, punkt c).

ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że brak dołączenia do oferty ww. załącznika lub też nieprawidłowe uzupełnienie ww. załącznika będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium nr 5 wynosi 10.

- 6) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wskutek oceny wszystkich kryteriów – 100 punktów wg wzoru $W = W_{k1} + W_{k2} + W_{k3} + W_{k4} + W_{k5}$.
- 7) Ocena punktowa będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem ewentualnej cyfry na trzecim miejscu o wartości od 1 do 4 w dół, a od 5 do 9 – w górę.
- 8) Dniem roboczym jest dzień inny niż ustawowo wolny od pracy oraz inny niż sobota.

XXV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. W celu usprawnienia procesu przygotowania umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU, na jego wniosek, edytowalnej wersji załączników do formularza ofertowego.
2. ZAMAWIAJĄCY zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Ustawy, po upływie terminów wskazanych w art. 264 ust. 1 Ustawy albo w warunkach, o których mowa w art. 264 ust. 2 Ustawy.
3. WYKONAWCA ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 6 do SWZ**. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
4. WYKONAWCY wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) najpóźniej przed podpisaniem umowy przedstawia ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy regulującej współpracę tych WYKONAWCÓW.
5. WYKONAWCY składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za podpisanie umowy.
6. ZAMAWIAJĄCY preferuje możliwość zawarcia umowy za pomocą środków elektronicznych z wykorzystaniem **kwalifikowanego podpisu elektronicznego**.
7. W przypadku braku możliwości zawarcia umowy w formie elektronicznej, ZAMAWIAJĄCY wyśle dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej umowy na adres WYKONAWCY pocztą, lub przesyłką kurierską. Wysyłka nastąpi z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych poprzedzających dzień oznaczony w umowie, jako dzień jej zawarcia.
8. WYKONAWCA w terminie **trzech dni roboczych** zwróci jeden podpisany egzemplarz umowy. Zwłoka WYKONAWCY w podpisaniu i zwrocie umowy zostanie uznana za odmowę zawarcia umowy, ze skutkami z tego wynikającymi.
9. Jeżeli WYKONAWCA, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych złożonych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.
10. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU:
 - 1) Ulotek odczynnikowych (w języku polskim) zawierających szczegółowe dane w tym: zastosowanie, postępowanie z odczynnikami, przechowywanie i trwałość odczynników, prowadzenie kontroli jakości, zakresy pomiarowe i rozcieńczenia, zakresy referencyjne oraz ograniczenia (substancje interferujące), liniowość reakcji (dotyczy każdej pozycji zaoferowanych odczynników).
 - 2) Oświadczenie o aktualności podstaw wykluczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (**Załącznik nr 11 do SWZ**).
 - 3) Szczegółowej instrukcji w języku polskim dotyczącej systemu biochemiczno-immunochemicznego.
 - 4) Szczegółowej instrukcji automatycznego systemu przedanalizycznego w języku polskim.
 - 5) Wypełnioną ankietę dostawcy (plik elektroniczny w formacie XLS - **Załącznik nr 12 do SWZ** (załącznik stanowi osobny plik), dokument nie jest wymagany

w przypadku, gdy WYKONAWCA przedstawi aktualny ważny certyfikat ISO/IEC 27001. Na podstawie ankiety ZAMAWIAJĄCY oceni ryzyka związane z korzystaniem z usług i produktów WYKONAWCY i dobierze odpowiednie środki bezpieczeństwa adekwatne do poziomu tego ryzyka (t.j. przeszkolenie personelu WYKONAWCY, przeprowadzenie kontroli i audytów bezpieczeństwa, częstsza kontrola i monitorowanie przekazywanych danych).

XXVI.OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada, poniżej, informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY na etapie przygotowania i złożenia oferty, oraz na etapie realizacji zamówienia:

- 1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski, kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl , nr telefonu 91 42 51 410, wew. 621.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

PN-13/26 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

- 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 Ustawy,
- 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- 6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację zamówienia jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy,
- 7) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 8) osoby działające w imieniu WYKONAWCY mają prawo:
 - do dostępu do danych osobowych ich dotyczących,
 - do sprostowania lub uzupełnienia ich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
 - do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgłoszenie takiego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
 - do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

- 9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
- do usunięcia danych osobowych,
 - do przenoszenia danych osobowych,
 - do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

ZAMAWIAJĄCY przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ZAMAWIAJĄCEMU w związku z prowadzonym postępowaniem i które ZAMAWIAJĄCY pozyska od WYKONAWCY biorącego udział w postępowaniu.

XXVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.

1. Środki ochrony prawnej przysługują WYKONAWCY, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów Ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Warunki formalne odwołania reguluje Ustawa.
3. WYKONAWCA ma prawo wnieść odwołanie na:
 - 1) niezgodną z przepisami Ustawy czynność ZAMAWIAJĄCEGO, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której ZAMAWIAJĄCY był obowiązany na podstawie Ustawy,
 - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Ustawy, mimo że ZAMAWIAJĄCY był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym, w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środkami komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołujący przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony.

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizacyjnego.

- Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

ZATWIERDZAM:

Jolanta Walczak - Pełnomocnik

/dokument podpisany elektronicznie/

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

Załącznik techniczny nr 1: Opis przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji sieciowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

- Załącznik nr 1: Szczegółowy opis systemu biochemiczno – immunochemicznego
- Załącznik nr 2: Szczegółowy opis systemu przedanalizacyjnego
- Załącznik nr 3: Ocena parametrów systemu biochemiczno – immunochemicznego, odczynników biochemicznych i immunochemicznych
- Załącznik nr 4: Rzut pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji 2 systemów biochemiczno – immunochemicznych i 2 stacji wody oraz sortera, instalacji prądowej i sieciowej
- Załącznik nr 5: Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 6: Projekt umowy
- Załącznik nr 7: Formularz ofertowy
- Załącznik nr 8: Oświadczenie o braku innych podstaw wykluczenia
- Załącznik nr 8a: Oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań funkcjonalnych oferowanego przedmiotu dostawy i dzierżawy.
- Załącznik nr 9: Oświadczenie WYKONAWCY o aktualności informacji
- Załącznik nr 10: Oświadczenie WYKONAWCY o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Załącznik nr 11: Oświadczenie o aktualności danych
- Załącznik nr 12: Ankieta dostawcy

*Załącznik techniczny nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26*

*Załącznik techniczny nr 1
do umowy nr PN-13/26*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI SIECIOWEJ
W ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM ONKOLOGII**

(osobny plik)

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

Załącznik nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Załącznik nr 1
do umowy nr PN-13/26

SZCZEGÓŁOWY OPIS SYSTEMU BIOCHEMICZNO – IMMUNOCHEMICZNEGO

1. Informacje ogólne dotyczące analizatorów:

LP.	WYMAGANIA	wypełnia WYKONAWCA
1.	dwa identyczne, zintegrowane systemy biochemiczno-immunochemiczne : 1 aparat fabrycznie nowy (rok produkcji 2025/2026), 1 aparat używany (rok produkcji nie starszy niż 2022)	
2.	nazwa aparatów (dwa identyczne)	
3.	producent (nazwa/siedziba)	
4.	model	

2. Wymagania funkcjonalne dotyczące **systemu biochemiczno-immunochemicznego**:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY SYSTEMU	TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA)
1.	zintegrowany system zarządzany z jednego stanowiska operatorskiego, umożliwiający aspirację materiału do badań biochemicznych i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami, 1 aparat fabrycznie nowy (rok produkcji 2025/2026), 1 aparat używany (rok produkcji nie starszy niż 2022), o wymiarach ≤ 2 600 x 1100 x 1 800 mm, system wolnostojący	
2.	deklaracja CE na analizator i odczynniki	
3.	w przypadku awarii jednego z modułów możliwość pracy na drugim module	
4.	analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie "pacjent po pacjencie"	
5.	techniki pomiarowe: spektrofotometria, turbidymetria, chemiluminescencja, pomiar jonoselektywny ISE (elektrody Na, K, Cl-bezobsługowe, tj. niewymagające uzupełniania płynów)	
6.	oprogramowanie oraz dostarczona dokumentacja w języku polskim	
7.	podłączenie przez WYKONAWCĘ systemu do szpitalnej sieci komputerowej (w przypadku braku dostępnych gniazd sieciowych należy je wykonać w ramach realizacji zamówienia) – program Eskulap, Jeśli wymagana jest licencja (licencje) to WYKONAWCA powinien je dostarczyć	
8.	dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym - Eskulap	

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

9.	dwukierunkowe, internetowe połączenie zdalne do celów diagnostyki serwisowej i aplikacyjnej	
10.	zewnętrzny UPS, umożliwiający, w przypadku zaniku zasilania, dokończenie wykonywania rozpoczętych badań (podtrzymanie pracy minimum 30 min.) UPS sprawdzany podczas przeglądu technicznego, baterie okresowo wymieniane, w celu zachowania pełnej sprawności na okres obowiązującej umowy	
11.	w ramach dzierżawy należy uwzględnić instalację i serwisowanie (w tym materiały zużywalne, wymiana filtrów) dwóch stacji wody (dla każdego aparatu oddzielna stacja), jeśli stacja jest wymagana do oferowanego sprzętu, oferent ponosi całkowity koszt instalacji pomiędzy analizatorem a stacją wody, która znajdować się będzie w innym pomieszczeniu, rozmieszczenie pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji analizatorów i stacji wody stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (rzut pomieszczeń)	
12.	podajnik próbek z minimum 50 pozycjami i możliwością ciągłego ich dostawiania w czasie pracy – proszę podać ilość próbek	
13.	identyfikacja przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych lub za pomocą technologii RFID	
14.	stałe monitorowanie stanu i ilości odczynników oraz materiałów zużywalnych	
15.	chłodzenie odczynników na pokładzie modułów w temperaturze zalecanej przez producenta	
16.	odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości	
17.	WYKONAWCA zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań materiały zużywalne (kuwety, naczynka, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu)	
18.	możliwość kalibracji i kontroli oczekujących odczynników	
19.	możliwość automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości reakcji	
20.	wbudowany wewnętrzny system kontroli	
21.	System mobilny wspierający zarządzanie analizatorami w laboratorium i do połączenia z centrum wsparcia	
22.	wewnątrzlaboratoryjny program kontroli badań połączony z międzylaboratoryjną oceną jakości – proszę wkleić krótki opis programu	
23.	zapewnienie zewnętrznego programu kontroli jakości RIQAS przez okres trwania umowy dla wszystkich parametrów podanych w Załączniku nr 5 (RQ9112/c, RQ9125/b, RQ9190, RQ9142) Labquality 3160 (mocz – ilościowe badanie moczu), Labquality 2700S (markery nowotworowe)	
24.	przeprowadzenie szkolenia użytkowników oraz administratorów ZAMAWIAJĄCEGO z zakresu bieżącej obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń wraz z imiennymi certyfikatami dla przeszkolonych osób, w tym dostarczenie dokumentacji poszkoleniowej dla użytkownika oraz administratora	
25.	WYKONAWCA dostarczy do zainstalowanych urządzeń objętych umową wersję drukowaną w języku polskim: – karty gwarancyjnej – paszportu technicznego – deklaracji zgodności CE – specyfikacji technicznej – instrukcji obsługi i konserwacji	

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizacyjnego.

	<ul style="list-style-type: none"> – kart charakterystyk substancji niebezpiecznych – ulotek metodycznych – protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń 	
26.	serwis i przeglądy techniczne (zgodnie z zaleceniami producenta, min. raz w roku) na koszt WYKONAWCY (w tym wymiana części).	
27.	dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej systemu dla Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnego z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi ISO (w tym m.in. schemat i opis infrastruktury, plan wykonywania/odtworzenia/weryfikacji poprawności kopii zapasowych [bazy danych oraz konfiguracji], plan odtworzenia, analiza ryzyka).	

3. Wymagania funkcjonalne dotyczące **modułu biochemicznego**:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY DLA MODUŁU BIOCHEMICZNEGO	TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA)
1.	wydajność części biochemicznej (z ISE) min. 500 ozn./godz. – proszę podać	
2.	metody pomiaru: <ul style="list-style-type: none"> – spektrofotometryczna (system fotometrii punktowej), – potencjometria jonoselektywna - min. Na, K, Cl, – turbidymetria 	
3.	praca analizatora w systemie rutynowym i "na cito", w trybie „pacjent po pacjencie”	
4.	możliwość oznaczeń w surowicy, osoczu, PMR, moczu	
5.	oznaczanie enzymów, substratów, ISE, białek specyficznych i leków (wskazanych w Załączniku nr 5 do SWZ)	
6.	jednoczesna dostępność minimum 40 parametrów	
7.	możliwość wykorzystania próbek "pierwotnych" i "wtórnych" (pipetowanych)	
8.	czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 15 minut	
9.	kuwety reakcyjne wielorazowego użytku	
10.	automatyczne wykrywanie skrzepu i poziomu płynów w próbce badanej podczas aspiracji	
11.	dostawianie odczynników w trakcie pracy analizatora	
12.	bezkontaktowe mieszanie odczynników i próbek, zapobiegające kontaminacji	
13.	opcja wykonania lub wczytania kalibracji z możliwością rekalkulacji	
14.	wykonywanie obliczeń statystycznych: <ul style="list-style-type: none"> - ilość wykonywanych badań w wybranym przedziale czasu, - ilość wykorzystanych odczynników w wybranym przedziale czasu 	

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

4. Wymagania funkcjonalne dotyczące **modułu immunochemicznego**:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY DLA MODUŁU IMMUNOCHEMICZNEGO	TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA)
1.	Metoda pomiaru chemiluminescencyjna	
2.	Podstawowy panel oznaczeń: – markery nowotworowe: AFP, CEA, PSA-T, CA125, CA15.3, CA19.9, HE4, SCC-Ag, CA 72-4 – dla panelu CA125+HE4 wymagane wprowadzenie do systemu informatycznego obliczanie algorytmu ROMA – β -HCG przeznaczony do monitorowania pacjentów z chorobami trofoblastycznymi (potwierdzone przez producenta w ulotce odczynnika) oraz wykrywania i monitorowania ciąży – diagnostyka tarczycy: TSH, FT3, FT4 – diagnostyka hormonalna: testosteron, FSH, estradiol – diagnostyka zakażeń: PCT met. Brahmsa – diagnostyka kardiologiczna: Troponina wyskoczła (o współczynniku nieprecyzyjności $\leq 10\%$ dla 99 percentyla wartości u osób zdrowych), NTproBNP, – diagnostyka stanów zapalnych- Interleukina 6	
3.	wydajność części immunochemicznej min. 100 ozn./godz. – proszę podać	
4.	dostępność minimum 25 pozycji odczynnikowych	
5.	czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut	
6.	automatyczne wykrywanie skrzepu i poziomu płynów w próbce badanej podczas aspiracji	
7.	jednorazowe naczynka reakcyjne i końcówki dozujące materiał badany	
8.	możliwość zaprogramowania automatycznych czynności konserwujących	

_____ dnia _____ 2026 r.

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

Załącznik nr 2
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Załącznik nr 2
do umowy nr PN-13/26

OPIS SYSTEMU PRZEDANALIZYCZNEGO

1. Informacje ogólne:

LP.	WYMAGANIA	wypełnia WYKONAWCA
1.	automatyczny system przedanalizyczny (rok produkcji – nie starszy niż 2022)	
2.	nazwa systemu	
3.	producent (nazwa/siedziba)	
4.	model	

2. Szczegółowe parametry techniczne urządzenia:

Poniższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

LP.	WYMAGANE PARAMETRY SYSTEMU	TAK / NIE (wypełnia WYKONAWCA)
1.	kompaktowy, wolnostojący system, wybiórczo zdejmujący korki z probówek, sortujący próbki na wszystkie systemy analityczne wykorzystywane w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej ZAMAWIAJĄCEGO (aparat hematologiczny, aparat koagulologiczny, aparat biochemiczno-immunochemiczny) oraz archiwizujący próbki	
2.	maksymalne wymiary: szer. x gł. x wys.: 100 cm x 120 cm x 180 cm	
3.	przepustowość minimum 400 próbek/godz.	
4.	podłączenie systemu do szpitalnej sieci komputerowej – program Eskulap	
5.	dowolne definiowanie pól wejścia/wyjścia	
6.	obsługujący probówki zamkniętego systemu pobierania różnych producentów o wymiarach: - ø zewnętrzne 11,5 - 13 mm, - wysokość całkowita z korkiem 65 – 110 cm	
7.	serwis i przeglądy techniczne wraz z dojazdami i kosztami zaopatrzenia (zgodnie z zaleceniami producenta, min. raz w roku) na koszt WYKONAWCY	
8.	dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej systemu dla Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnego z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi ISO (w tym m.in. schemat i opis infrastruktury, plan wykonywania/odtworzenia/weryfikacji poprawności kopii zapasowych [bazy danych oraz konfiguracji], plan odtworzenia, analiza ryzyka)	

_____ dnia _____ 2026 r.

podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

Załącznik nr 3
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Załącznik nr 3
do umowy nr PN-13/26

**OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH I TECHNICZNYCH SYSTEMU BIOCHEMICZNO –
IMMUNOCHEMICZNEGO ORAZ OCENA JAKOŚCI ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH
I IMMUNOCHEMICZNYCH**

a) Ocena punktowana systemu biochemiczno – immunochemicznego:

LP.	OPIS PARAMETRÓW	WYMAGANIA TAK/NIE (Wypełnia WYKONAWCA)	ilość punktów TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 12 pkt)
1.	funkcja powtórzenia oznaczenia automatyczna i manualna (rerun)		
2.	automatyczna funkcja zlecenia dodatkowych badań (reflex test)		
3.	Ilościowa identyfikacja hemolizy, lipemii i żółtaczki		
4.	system zapobiegający kontaminacji próbek i odczynników – proszę podać krótką informację		
5.	manualna i automatyczna akceptacja wyników		
6.	możliwość wywołania nazwiska pacjenta wg ID		
7.	archiwizacja wyników		
8.	czas uzyskania wyniku dla Troponiny nie dłuższy niż 10 minut		
9.	odczynnik do oznaczania Troponiny T		
10.	troponina test wysokoczuły, umożliwiający zastosowanie jednogodzinnego algorytmu diagnostycznego		
11.	bezpłatne wybrane przez użytkownika dwa pakiety startowe i niezbędne akcesoria do uruchomienia analizatora (NTproBNP, PCT)		
12.	wartość Lpa w nmol/l/l		
Wartość uzyskanych punktów			

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

b) Ocena punktowana odczynników biochemicznych: (punktowana jest każda odpowiedź w kolumnach od 4 do 8).

LP.	NAZWA ODCZYNNIKA	ILOŚĆ OZNACZEŃ ROCZNIE	LINIOWOŚĆ REAKCJI (kolumna nr 4) (wypełnia WYKONAWCA)	WIELKOŚĆ ZESTAWU (IL. OZN. Z OPAK.) (kolumna nr 5) (wypełnia WYKONAWCA)	ODCZYNNIK ROBOCZY GOTOWY DO UŻYCIA (CIEKŁY) (kolumna nr 6) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA)	TRWAŁOŚĆ ODCZYNNIKA NA POKŁADZIE ANALIZATORA (PO OTWARCIU) (kolumna nr 7) (wypełnia WYKONAWCA)	LIMITY CZASOWE KALIBRACJI (kolumna nr 8) (wypełnia WYKONAWCA)	SUMA PUNKTÓW (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 214 pkt) Kolumna nr 4-5, 7-8 NAJWIĘCEJ: 2 PKT POŚREDNIO: 1 PKT NAJMNIEJ: 0 PKT Kolumna nr 6 TAK: 1 PKT NIE: 0 PKT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Albuminy	6650						
2.	Aminotransferaza alan.ALT	50908						
3.	Aminotransferaza asp. AST	50908						
4.	Amylaza	2380						
5.	Białko całkowite	6215						
6.	Białko C-reaktywne	20950						
7.	Białko w moczu	1645						
8.	Bilirubina bezpośrednia	2200						
9.	Bilirubina całkowita	42366						
10.	Cholesterol całkowity	2000						
11.	Cholesterol-HDL	1360						
12.	Dehydrogenaza mlecz. LDH	9967						
13.	Fosfataza alkaliczna	29509						
14.	Fosforany nieorg.	2085						
15.	Gamma-glutamyllopeptydaza	4384						
16.	Glukoza	23157						
17.	Kreatynina	60834						
18.	Kwas moczowy	6600						
19.	Lp (a)	500						
20.	Magnez	16540						

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

21.	Mocznik	36042						
22.	Prealbuminy	2858						
23.	Triglicerydy	1743						
24.	Wankomycyna	650						
25.	Wapń całkowity	27982						
26.	Żelazo	3409						
27.	Jonogram (Na, K, Cl)	3 x 51 410	PROSZĘ PODAĆ TRWAŁOŚĆ KAŻDEJ ELEKTRODY (wypełnia WYKONAWCA)					
			DO 1/2 ROKU: 0 PKT 1/2-1 ROKU: 1 PKT WIĘCEJ NIŻ 1 ROK: 2 PKT					
			WARTOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW NAJWIĘCEJ – najwyższa wartość z wszystkich złożonych ofert POŚREDNIO – średnia wartość z wszystkich złożonych ofert NAJMNIEJ – najniższa wartość z wszystkich złożonych ofert					

Badania: bilirubina bezpośrednia, triglicerydy, cholesterol, cholesterol-HDL, amylaza, żelazo, fosforany, prealbumina, wankomycyna, Lp(a), białko w moczu - będą wykonywane na jednym aparacie. Pozostałe badania będą wykonywane równocześnie na dwóch aparatach.

b) Ocena punktowana odczynników immunochemicznych: (punktowana jest każda odpowiedź w kolumnach od 4 do 8)

LP.	NAZWA ODCZYNNIKA	IŁOŚĆ OZNACZEŃ ROCZNIE	WIELKOŚĆ ZESTAWU (IL .OZN. Z OPAK.) (kolumna nr 4) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA)	DOLNA GRANICA WYKRYWALNOŚCI (kolumna nr 5) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA)	GÓRNY ZAKRES POMIAROWY (kolumna nr 6) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA)	TRWAŁOŚĆ ODCZYNNIKA NA POKŁADZIE ANALIZATORA (PO OTWARCIU) (kolumna nr 7) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA)	CZAS WYKONANIA OZNACZENIA, OD MOMENTU WSTAWIENIA DO ANALIZATORA (kolumna nr 8) TAK/NIE (wypełnia WYKONAWCA)	SUMA PUNKTÓW (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 105 pkt) TAK – 1 PKT NIE – 0 PKT
1.	AFP	1950	≥100	≤ 0,500 IU/ml	≥ 1000 IU/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
2.	CA 125	4500	≥200	≤ 0,600 U/ml	≥5000 U/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
3.	CA 15-3	5742	≥200	≤1,0 U/ml	≥300,0 U/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
				P				

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

4.	CA 19-9	4011	≥200	≤ 0,600 U/ml	≥1000 U/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
5.	CEA	8175	≥200	≤ 0,200 ng/ml	≥ 1000 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
6.	Estradiol	1010	≥200	≤ 0,010 ng/ml	≥50,00 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
7.	Interleukina 6	3600	≤ 100	≤ 1,50 pg/ml	≥5000 pg/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
8.	β-HCG	1992	≥100	≤ 0,10 mIU/ml	≥10000 mIU/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
9.	PSA -T	9000	≥200	≤ 0,006 ng/ml	≥100 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
10.	Testosteron	2716	≥200	≤ 0,025 ng/ml	≥15 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
11.	HE4	575	≤ 100	≤ 5,00 pg/ml	≥4000 pg/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
12.	Witamina D	1312	≥300	≤ 3,00 ng/ml	≥120 ng/ml	≥ 50 dni	≤ 30 min	
13.	CA 72-4	400	≥100	≤ 0,5 U/ml	≥250 U/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
14.	SCC-Ag	400	≤ 100	≤ 0,1 ng/ml	≥70 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
15.	NTproBNP	400	≤ 100	≤ 5,00 ng/ml	≥35000 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
16.	FSH	975	≥300	≤ 0,10 mIU/ml	≥200 mIU/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
17.	PCT (Brahms)	8716	≥200	≤ 0,02 ng/ml	≥100 ng/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	
18.	TSH	11450	≥200	≤ 0,005μIU/ml	≥100μIU/ml	≥ 100 dni	≤ 20 min	

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

19.	Troponina (wysokoczuła)	1950	≥200	≤ 0,003μg/l	≥10,00μg/l	≥ 100 dni	≤ 10 min	
20.	FT3	7695	≥200	≤ 0,500pmol/l	≥50,00pmol/l	≥ 100 dni	≤ 20 min	
21.	FT4	8768	≥200	≤ 0,400pmol/l	≥100,00pmol/l	≥ 100 dni	≤ 20 min	
WARTOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW								

Badania: HE4, troponina T, estradiol, FSH, interleukina 6, testosteron – będą wykonywane na jednym aparacie. Pozostałe badania będą wykonywane równocześnie na dwóch aparatach.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW <i>(maksymalna całkowita liczba punktów możliwych do uzyskania: 331 pkt)</i>	
---	--


_____ dnia _____ 2026 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

Załącznik nr 4
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Załącznik nr 4
do umowy nr PN-13/26

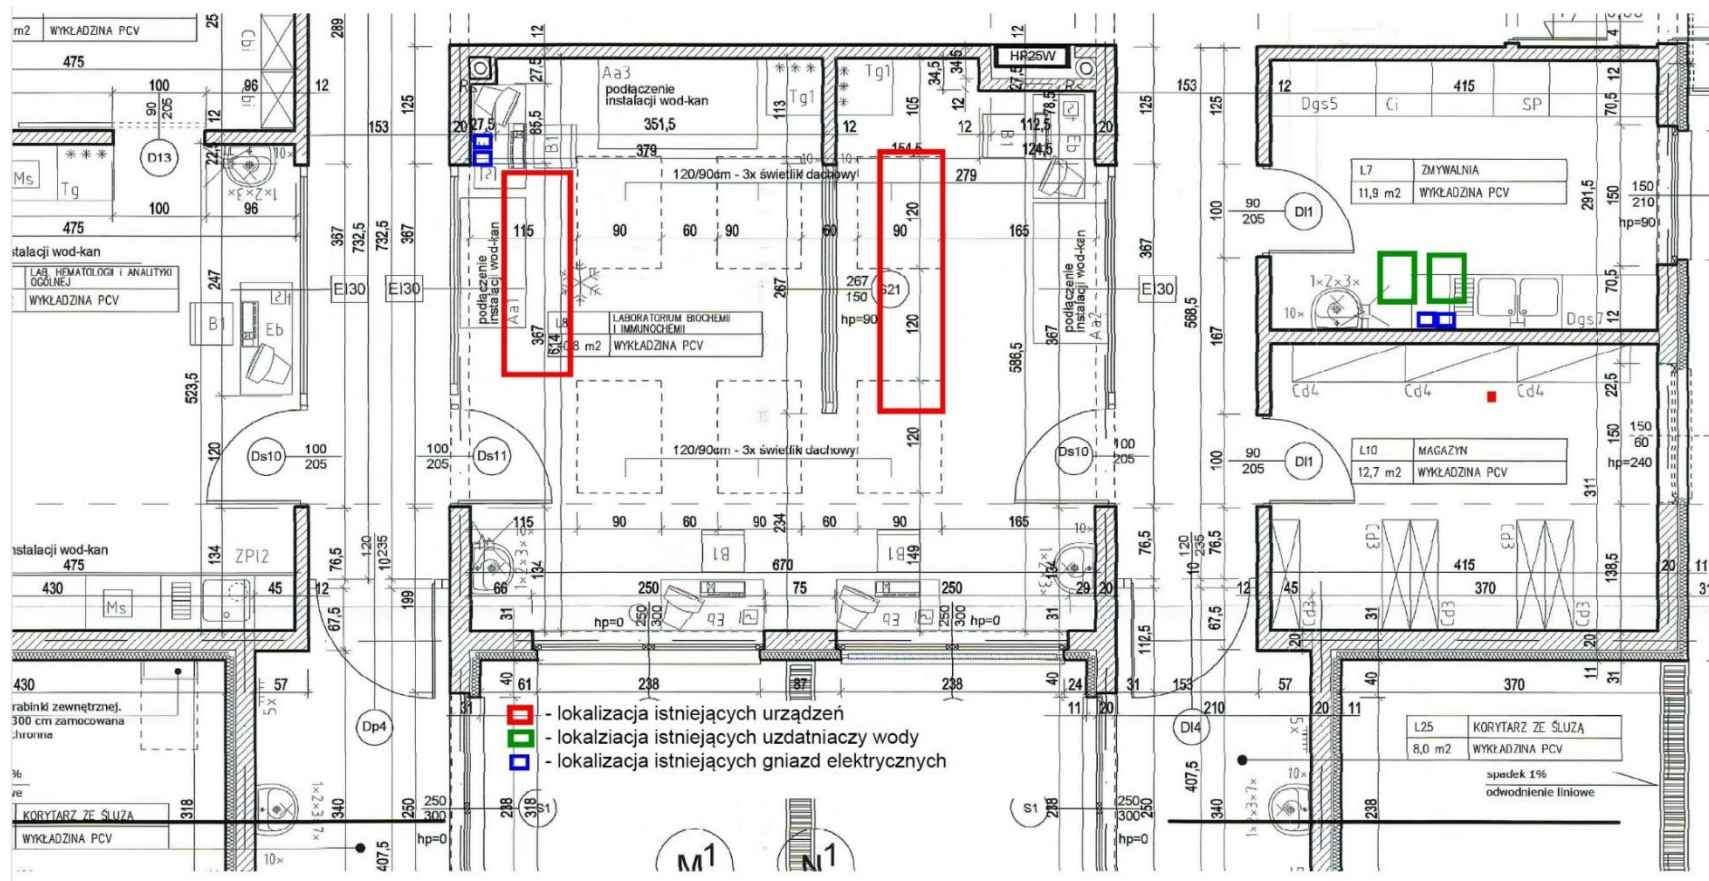

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

Załącznik nr 5
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Załącznik nr 5
do umowy nr PN-13/26

SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CENY JEDNOSTKOWE

Proszę poniżej odpowiednio wypełnić zestawienia: **(Ilość opakowań (pełnych) odczynników, kalibratorów, materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania liczby podanych oznaczeń, ilość materiałów kontrolnych niezbędnych do prowadzenia codziennej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na min. dwóch poziomach, numery katalogowe oferowanych odczynników).**

1. ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE:

lp.	nazwa odczynnika	ilość oznaczeń rocznie	nr katalogowy	nazwa produktu	wielkość opakowania	liczba opakowań na rok	cena opakowania netto [zł]	stawka VAT [%]	cena opakowania brutto [zł]	wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
1.	Albuminy	6650									
2.	Aminotransferaza alan.ALT	50908									
3.	Aminotransferaza asp. AST	50908									
4.	Amylaza	2380									
5.	Białko całkowite	6215									
6.	Białko C-reaktywne	20950									
7.	Białko w moczu	1645									
8.	Bilirubina bezpośrednia	2200									
9.	Bilirubina całkowita	42366									
10.	Cholesterol całkowity	2000									
11.	Cholesterol-HDL	1360									
12.	Dehydrogenaza mlecz. LDH	9967									
13.	Fosfataza alkaliczna	29508									
14.	Fosforany nieorg.	2085									

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

15.	Gamma-glutamyllopeptydaza	4384									
16.	Glukoza	23157									
17.	Kreatynina	60834									
18.	Kwas moczowy	6600									
19.	Lp(a)	400									
20.	Magnez	16540									
21.	Mocznik	36042									
22.	Prealbuminy	2858									
23.	Triglicerydy	1743									
24.	Wankomycyna	650									
25.	Wapń całkowity	27982									
26.	Żelazo	3409									
27.	Jonogram (Na, K, Cl)	3x51410									
										WARTOŚĆ ZA 12 MIESIĘCY	
										WARTOŚĆ ZA 48 MIESIĘCY	

2. ODCZYNNIKI IMMUNOCHEMICZNE:

lp.	nazwa odczynnika	ilość oznaczeń rocznie	nr katalogowy	nazwa produktu	wielkość opakowania	liczba opakowań na rok	cena opakowania netto [zł]	stawka VAT [%]	cena opakowania brutto [zł]	wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
1.	AFP	1950									
2.	CA 125	4500									
3.	CA 15-3	5742									
4.	CA 19-9	4011									
5.	CEA	8175									
6.	Estradiol	1010									
7.	β-HCG	1992									
8.	PSA -T	9000									
9.	Testosteron	2716									
10.	HE4	575									

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

11.	Witamina D	1312									
12.	SCC-Ag	400									
13.	NTproBNP	400									
14.	CA 72-4	400									
15.	FSH	975									
16.	PCT (Brahms)	8716									
17.	TSH	11450									
18.	Troponina (wysokoczuła)	1950									
19.	FT3	7695									
20.	FT4	8768									
21.	Interleukina 6	3600									
WARTOŚĆ ZA 12 MIESIĘCY											
WARTOŚĆ ZA 48 MIESIĘCY											

3. SUROWICE KONTROLNE, KALIBRATORY I INNE NIEZBĘDNE ODCZYNNIKI I AKCESORIA:

lp.	nazwa	ilość oznaczeń rocznie	nr katalogowy	nazwa produktu	wielkość opakowania	liczba opakowań na rok	cena opakowania netto [zł]	stawka VAT [%]	cena opakowania brutto [zł]	wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
1.	Surowice kontrolne (min. dwa zakresy)	*)									
2.	Kalibratory	**)									
3.	Niezbędne odczynniki dodatkowe i akcesoria										
WARTOŚĆ ZA 12 MIESIĘCY											
WARTOŚĆ ZA 48 MIESIĘCY											

*)Ilość niezbędna do codziennej kontroli w/w parametrów wykonywanych w ilości≥2000 badań/rok, dla pozostałych 3x w tygodniu.

**)Wieloparametrowe i indywidualne - ilość stosowna do limitów czasowych kalibracji i trwałości kalibratorów po otwarciu.

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalitycznego.

4. DZIERŻAWA DWÓCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW BIOCHEMICZNO-IMMUNOCHEMICZNYCH I AUTOMATYCZNEGO SYSTEMU PRZEDANALITYCZNEGO:

lp.	nazwa	ilość rat rocznie	wartość miesięczna netto [zł]	stawka VAT [%]	wartość miesięczna brutto [zł]	wartość netto [zł]	wartość brutto [zł]
1.	czynsz dzierżawny – aparat nr 1	12					
2.	czynsz dzierżawny – aparat nr 2	12					
3.	czynsz dzierżawny – system przedanalityczny	12					
WARTOŚĆ ZA 12 MIESIĘCY							
WARTOŚĆ ZA 48 MIESIĘCY							

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZA 12 MIESIĘCY <i>(z uwzględnieniem dzierżawy)</i>	NETTO	BRUTTO
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZA 48 MIESIĘCY <i>(z uwzględnieniem dzierżawy)</i>	NETTO	BRUTTO

_____ dnia _____ 2026 r.

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY

UMOWA PN-13/26 – projekt

pomiędzy:

Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, 71-730 Szczecin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048836, posiadającym NIP 8512537776, Regon 000817391, zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu którego działają:

1. ...
2. ...

a firmą ..., z siedzibą w ..., ul. ... , ..., wpisaną do ... pod nr ..., posiadającą NIP ..., Regon ..., zwaną w treści umowy „WYKONAWCĄ”, w imieniu którego działają:

1. ...
2. ...

została zawarta umowa następującej treści:

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w przetargu nieograniczonego w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego w dniu ... r. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek **dostawy odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych i automatycznego systemu przedanalizacyjnego** szczegółowo opisanych w **Załączniku nr 1, 2, 3 do umowy** w ilości i za cenę określoną w **Załączniku nr 5 do umowy** zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ofertą WYKONAWCY stanowiącymi integralną część umowy.
2. Przedmiot zamówienia, w tym dzierżawa analizatorów, będzie realizowany do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 pkt. 1) odnoszącej się do dostawy odczynników i ich zużycia odczynników przez ZAMAWIAJĄCEGO, nie dłużej jednak niż **48 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy przez dwie strony** przy czym:
 - 1) dostarczenie i uruchomienie **pierwszego analizatora zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego** nastąpi **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy**,
 - a. analizator należy uruchomić i podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap - integracja dwukierunkowa (na wzór integracji obecnej, wraz z aktualnie zleconą integracją sortera) (integrację WYKONAWCA

- ma zlecić **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy** i poinformować o tym Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO,
- b. **14 dni kalendarzowych przed dostarczeniem urządzeń** (w przypadku kilku dostaw należy procedurę powtórzyć dla każdej z dostaw osobno) poinformować Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji o dostawie,
 - c. **7 dni kalendarzowych przed dostawą** potwierdzić w Dziale Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji termin instalacji urządzeń,
 - d. przeszkolić personel ZAMAWIAJĄCEGO zakończony protokołem ze szkolenia,
- 2) dostarczenie i uruchomienie **drugiego analizatora zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego** nastąpi **do 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy**,
- a. analizator należy uruchomić i podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap - integracja dwukierunkowa (na wzór integracji obecnej, wraz z aktualnie zleconą integracją sortera) (integrację WYKONAWCA ma zlecić **do 14 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy** i poinformować o tym Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO,
 - b. **14 dni kalendarzowych przed dostarczeniem urządzeń** (w przypadku kilku dostaw należy procedurę powtórzyć dla każdej z dostaw osobno) poinformować Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji o dostawie,
 - c. **7 dni kalendarzowych przed dostawą** potwierdzić w Dziale Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji termin instalacji urządzeń,
 - d. przeszkolić personel ZAMAWIAJĄCEGO zakończony protokołem ze szkolenia,
- 3) dostarczenie i uruchomienie **automatycznego systemu przedanalizacyjnego** nastąpi **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy**,
- a. system należy uruchomić i podłączyć do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap - integracja dwukierunkowa (na wzór integracji obecnej, wraz z aktualnie zleconą integracją sortera) (integrację WYKONAWCA ma zlecić **do 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy** i poinformować o tym Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ZAMAWIAJĄCEGO,
 - b. **14 dni kalendarzowych przed dostarczeniem urządzeń** (w przypadku kilku dostaw należy procedurę powtórzyć dla każdej z dostaw osobno) poinformować Dział Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji o dostawie,
 - c. **7 dni kalendarzowych przed dostawą** potwierdzić w Dziale Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji termin instalacji urządzeń,
 - d. przeszkolić personel ZAMAWIAJĄCEGO zakończony protokołem ze szkolenia,
- 4) pierwsza dostawa odczynników nastąpi wraz z uruchomieniem **pierwszego analizatora** zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego, zgodnie z zamówieniem ZAMAWIAJĄCEGO, złożonym w dniu podpisania umowy.
3. Miejscem dostawy, wniesienia, rozładowania towaru, dzierżawy jest Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej ZAMAWIAJĄCEGO, przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie w budynku Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów (dojazd od ulicy Rolnej).
4. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień składanych przy użyciu poczty elektronicznej. Termin realizacji wynosi **do ... dnia roboczego** (zależy od treści złożonej

oferty) licząc od dnia złożenia zamówienia. Zamówienia będą składane najpóźniej do godziny 13:00 w dni robocze. WYKONAWCA każdorazowo w dniu otrzymania zamówienia zobowiązany jest do jego potwierdzenia telefonicznego lub pocztą elektroniczną z adnotacją o przyjęciu do realizacji i informacją o ewentualnych brakach magazynowych. Pod pojęciem dni roboczych rozumie się dzień inny niż ustawowo wolny od pracy oraz inny niż sobota.

5. ZAMAWIAJĄCY może zmniejszyć wielkość objętego umową przedmiotu zamówienia, w tym poszczególnych wyrobów w zależności od uzyskanych środków finansowych oraz potrzeby zastosowania produktów, objętych niniejszą umową, a w takim przypadku WYKONAWCY nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych. Ponadto ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania ilościami poszczególnych produktów w ramach dostaw odczynników (w tym surowic kontrolnych, kalibratorów oraz innych niezbędnych odczynników i akcesoriów) przy zachowaniu wartości umowy dla dostawy odczynników wskazanej w § 2 ust. 1 pkt 1). W takich sytuacjach, w tym w przypadku ograniczenia przedmiotu umowy WYKONAWCY nie przysługuje prawo do roszczeń odszkodowawczych. Jednakże wartość zamówienia w ramach niniejszej umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO nie może wynieść mniej niż 70% wartości określonej w § 2 ust. 1 pkt 1).
6. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne oraz działania lub zaniechania pracowników oraz innych osób, z których pomocą wykonuje zobowiązania objęte umową jak za własne działania lub zaniechania, w szczególności w przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy.
7. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów przy realizacji umowy, w tym dostarczenia przedmiotu spełniającego wszystkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami o wyrobach medycznych oraz posiadającego wszelkie wymagane przez przepisy prawa oznaczenia oraz dokumentację. Najpóźniej do momentu dostawy przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem jednak obowiązku przedłożenia dokumentów wskazanych w SWZ przy ofercie) WYKONAWCA prześle ZAMAWIAJĄCEMU ważne i aktualne na dzień dostawy dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu, w tym wszelkie dokumenty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów o wyrobach medycznych, w tym Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (rozporządzenie MDR) lub w przypadku wyrobu do diagnostyki in vitro rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylecia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (rozporządzenie IVDR). Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązuje się do przedkładania wymaganych dokumentów na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Ceny i zasady zmiany cen

§ 2.

1. Strony ustalają, że za **dostawę odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno-immunochemicznych i automatycznego systemu**

przedanalizycznego przez okres trwania umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę netto ... zł, cenę brutto ... zł, to jest słownie ... , zgodnie z **Załącznikiem nr do umowy**, w tym:

- 1) za dostawę przedmiotu zamówienia tj. odczynniki (w tym surowic kontrolnych, kalibratorów oraz innych niezbędnych odczynników i akcesoriów) w cenie **netto ... zł, to jest brutto: ... zł (słownie: ...)** z zastrzeżeniem ust. 2-3 poniżej. Rozliczenia stron z tytułu wykonywania umowy następować będą po każdej dostawie, a jej wartość objęta fakturą do której zapłaty zobowiązany będzie ZAMAWIAJĄCY stanowi będzie iloczyn liczby dostarczonych produktów i cen jednostkowych, zawartych w **Załączniku nr 5 do umowy**.
- 1) za dzierżawę przedmiotu zamówienia **w cenie netto ... zł, to jest brutto: ... zł (słownie: ...)** z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu dzierżawy wynosi **netto ... zł, brutto ... zł (słownie: ... 00/100)**. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie usługi w tym także w ramach serwisu świadczone przez WYKONAWCĘ na podstawie niniejszej umowy. Rozliczenia pomiędzy stronami nastąpi po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie faktury wystawionej z dołu. Warunkiem płatności pierwszej faktury jest realizacja przez WYKONAWCĘ wszystkich czynności wskazanych w §1 ust. 2 pkt 1)-3), potwierdzonych protokołami przekazania. W przypadku korzystania z przedmiotu dzierżawy przez niepełny miesiąc kalendarzowy, czynsz zostanie proporcjonalnie zmniejszony o liczbę dni niekorzystania,
2. Należność za dostawę/ dzierżawę płatna będzie przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy, wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność zostanie dokonana na rachunek bankowy określony w fakturze, z zastrzeżeniem, że musi on być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
3. WYKONAWCA wystawiać będzie faktury z tytułu dostawy po każdej dostawie. ZAMAWIAJĄCY wskazuje, że wartość pojedynczych zamówień wynosić będzie od 0,5% do 6% łącznej ceny brutto, przy czym wartość ostatniego zamówienia nie przekroczy 50% wartości z ust.1, pkt 1).
4. Na wypadek opóźnienia w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty, WYKONAWCA uprawniony będzie do powstrzymania się od spełnienia obowiązku kolejnych dostaw towaru do dnia zapłaty całości zaległych należności, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
5. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku dłużnika.
6. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z przepisami lub umową termin zapłaty liczy się od otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury.
7. Cena, określona w załączniku, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, a w szczególności należności celne i graniczne, koszty transportu oraz ubezpieczenia, wniesienia i rozładowania towaru, dzierżawę, naprawę oraz wszelkie inne koszty.
8. Wynagrodzenie WYKONAWCY może ulec zmianie w przypadku:
 - 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
 - 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z tym

- zastrzeżeniem, że wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartość wzrostu/spadku całkowitego kosztu WYKONAWCY wynikającą ze zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie w związku z dostosowaniem wynagrodzenia do wprowadzonych zmian, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych,
- 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartość wzrostu/spadku całkowitego kosztu WYKONAWCY w związku z przedmiotową zmianą przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,
 - 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w Ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, (Dz. U. 2024 poz. 427) z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie WYKONAWCY ulegnie zmianie o wartość wzrostu/spadku kosztu WYKONAWCY w związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie,
 - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ.
9. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 8 pkt 1-4, WYKONAWCA może wystąpić do ZAMAWIAJĄCEGO z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. WYKONAWCA powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uwagi na przedmiotowe zmiany może wystąpić ZAMAWIAJĄCY. Strony mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających ww. zmiany i dotyczyć będzie części wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za okres realizowania przedmiotu umowy przypadający po zaistnieniu zdarzeń wskazanych w ww. zapisach.
10. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 439 Ustawy PZP w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane powyżej jeżeli zmiana ta wpływa na koszt wykonania zamówienia. Zmiany wysokości wynagrodzenia będą dokonywane według zasad opisanych w ust. 11-14.
11. Każda ze Stron może żądać zmiany wynagrodzenia (odpowiednio podwyższenia lub obniżenia) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wyrażającej się zmianą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego komunikatem Prezesa GUS o ponad 5% za ostatni kwartał; przy czym wartość zmiany wskaźnika GUS porównywana będzie do wartości kwartalnego wskaźnika GUS obowiązującego na dzień otwarcia ofert, a w przypadku kolejnych zmian – do wartości wskaźnika GUS branego pod uwagę przy poprzedniej zmianie. ZAMAWIAJĄCY nie przewiduje zmian wynagrodzenia w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania umowy.
12. Wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia na podstawie ust. 10 i 11 może być złożony nie częściej niż raz na 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem postanowienia, o którym mowa w ust. 13, i musi zawierać uzasadnienie wraz z wyliczeniem nowej wysokości wynagrodzenia.

13. Ewentualna zmiana wynagrodzenia na podstawie ust. 10-12 dotyczyć będzie części wynagrodzenia za dotychczas niezrealizowaną część zamówienia przy czym zmiana może wejść w życie nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w której Strona złożyła wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zmiana odpowiadać będzie wartości wzrostu lub spadku kosztów realizacji zamówienia wynikającej ze zmiany wskaźnika GUS o którym mowa w ust. 11.
14. Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania powyższych postanowień z ust. 9-13 na poziomie 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.
15. WYKONAWCA, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10-14 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są dostawy oraz okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
16. Brak porozumienia stron w zakresie zmiany ceny, w warunkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowi podstawę do rozwiązania umowy w tej części przez stronę zainteresowaną, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.
17. W przypadku likwidacji ww. wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.

§2¹

1. Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku wystawiania, doręczania lub odbioru faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), w miejsce postanowień umowy dotyczących warunków wystawienia faktur, stosuje się poniższe postanowienia:
 - 1) podstawą do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury ustrukturyzowanej będzie odpowiedni protokół, zgodnie z postanowieniami w niniejszej umowie,
 - 2) w strukturze faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy użyciu KSeF należy wskazać następujące dane ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot 2 jako Nabywca: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin, NIP 851-25-37-776,
 - 3) W strukturze faktury ustrukturyzowanej należy umieścić dodatkowe dane w węźle „Warunki Transakcji” - informacji identyfikującej umowę, której dana faktura będzie dotyczyć, w tym numeru lub symbolu umowy w formacie: „Umowa nr PN-13/26”,
 - 4) ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem szczególnych przypadków niedostępności lub awarii systemu KSeF ściśle określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług,
 - 5) w przypadkach, o których mowa w pkt. 4, wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z wymaganymi prawem oznaczeniami (w tym kodami QR) należy przesłać na adres mailowy: faktury@onkologia.szczecin.pl , przy czym w przypadku braku numeru identyfikacyjnego KSeF, WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć ten numer niezwłocznie po jego nadaniu przez system (o ile przepisy nakładają obowiązek przesłania faktury do KSeF po ustaniu przypadku, o którym mowa w pkt 4),

- 6) faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przez ZAMAWIAJĄCEGO przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę fakturę z wyjątkiem szczególnych przypadków, o których mowa w pkt. 4,
 - 7) wynagrodzenie na podstawie niniejszej umowy płatne będzie przelewem w terminie wskazanym w umowie od dnia prawidłowo wystawionej faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF,
 - 8) w przypadku, gdy faktura ustrukturyzowana widoczna w KSeF będzie zawierała błędy w danych identyfikacyjnych, formalne, rachunkowe lub merytoryczne (w tym niezgodność z Umową lub protokołem odbioru), WYKONAWCA zobowiązany jest do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej w systemie KSeF. W takiej sytuacji termin zapłaty, nie biegnie od daty faktury pierwotnej, lecz rozpoczyna swój bieg na nowo w całości dopiero od dnia przydzielenia numeru identyfikacyjnego KSeF prawidłowej fakturze korygującej.
2. ZAMAWIAJĄCY nie pozostaje w opóźnieniu w spełnieniu świadczenia pieniężnego, a WYKONAWCY nie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od wystawienia faktury pierwotnej do upływu terminu płatności wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury korygującej.
 3. Przez fakturę ustrukturyzowaną, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć fakturę, o której mowa w art. 2 ust. 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Podatek od towarów i usług (Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.).
 4. Wynagrodzenie WYKONAWCY będzie płatne przelewem wyłącznie na rachunek bankowy WYKONAWCY, którego numer został zgłoszony w organie podatkowym i umieszczony w rejestrze podatników VAT. WYKONAWCA zobowiązuje się umieścić numer rachunku bankowego, o którym mowa w poprzednim zdaniu na każdej wystawionej przez siebie fakturze / ustrukturyzowanej fakturze.
 5. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie skutkują akceptacją wystawiania i doręczania ZAMAWIAJĄCEMU faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur do dnia odpowiednio obowiązującej WYKONAWCĘ daty wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowego Systemu e-faktur.

Postanowienia szczególne w zakresie dostaw

§ 3.

1. WYKONAWCA na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązuje się dostarczać dla przedmiotu zamówienia wymagane i aktualne dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. WYKONAWCA w chwili podpisania umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw tak, aby Umowę można było zrealizować, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie.
3. W przypadku braku dostępności przedmiotu zamówienia w związku z zaprzestaniem (trwałym lub czasowym) produkcji przedmiotu zamówienia przez producenta lub decyzją o wycofaniu produktu z obrotu, WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie udokumentować i powiadomić o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. W takiej sytuacji WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć zamiennik przedmiotu zamówienia o nie gorszych cechach i parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia **po wcześniejszym uzyskaniu zgody ZAMAWIAJĄCEGO**. Cena zamiennika nie może być wyższa niż przedmiotu zamówienia podanego w załączniku asortymentowym. W przypadku ustalenia we własnym zakresie przez ZAMAWIAJĄCEGO, że produkt będący przedmiotem zamówienia jest jednak dostępny u innego dostawcy ZAMAWIAJĄCY w pierwszej kolejności zastrzega sobie

możliwość dokonania zakupu tego produktu na zasadzie zakupu interwencyjnego (na koszt i ryzyko WYKONAWCY) i obciążenia WYKONAWCY ewentualną różnicą w cenie na podstawie noty obciążeniowej.

4. W przypadku dostarczania przez WYKONAWCĘ zamiennika na warunkach wskazanych w ust. 3 WYKONAWCA dostarcza zamiennik po cenie jednostkowej nie wyższej niż cena wynikająca z **Załącznika nr 5 do umowy** lub też może wypowiedzieć umowę na zasadach opisanych w § 12. W okresie wypowiedzenia WYKONAWCA dostarczać będzie zamiennik, o którym mowa w ust. 3 po cenie nie wyższej niż cena jednostkowa wynikająca z **Załącznika nr 5 do umowy**.
5. W przypadku, gdy WYKONAWCA z innych przyczyn niż wskazane w ust. 3 nie będzie w stanie dostarczyć zamówionego produktu, na który umowę zawarto, WYKONAWCA jest zobowiązany **dostarczyć za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO produkt inny**, o nie gorszych cechach i parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. **Cena produktu innego producenta nie może być wyższa niż przedmiotu zamówienia podanego w Załączniku nr 5 do umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega jednak**, że w przypadku gdy produkt będący przedmiotem zamówienia będzie jednak dostępny u innego dostawcy ZAMAWIAJĄCY może nie wyrazić zgody i w pierwszej kolejności będzie miał możliwość dokonania zakupu tego produktu na zasadzie zakupu interwencyjnego (na koszt i ryzyko WYKONAWCY) i obciążenia WYKONAWCY ewentualną różnicą w cenie na podstawie noty obciążeniowej.
6. W każdym przypadku odmowy dostarczenia przedmiotu zamówienia lub zamiennika na warunkach opisanych w ust. 4-5 lub też niezrealizowania zamówienia w przewidzianym umową terminie w godzinach wskazanych (od 7.00 a najpóźniej do godz. 14.00), ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego podmiotu na koszt i ryzyko WYKONAWCY a WYKONAWCA zobowiązuje się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny na podstawie noty obciążeniowej.
7. Dokonanie zakupu interwencyjnego zmniejsza odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu. Zakupy interwencyjne, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są bez dodatkowych zezwoleń sądu czy uprzedniej informacji dla WYKONAWCY.
8. Dostawa produktu zamiennego w przypadku, o którym mowa w ust. 3-5, nie wymaga zmiany umowy.
9. W przypadkach wymienionych w ust. 3-6 postanowienia o karach za zwłokę stosuje się.
10. Korzystanie przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa odstąpienia od zamówienia w warunkach wskazanych w niniejszej umowie pozostaje bez wpływu na prawo do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego.
11. Produkty będące przedmiotem dostawy posiadać muszą minimum roczny termin ważności. Dopuszcza się możliwość dostarczenia produktów z krótszym terminem ważności tylko po uprzednim uzyskaniu zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
12. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dowolnego dysponowania ilościami poszczególnych produktów w danym pakiecie , przy zachowaniu wartości danego pakietu.
13. Z czynności dostawy ZAMAWIAJĄCY sporządza protokół poświadczający wyłącznie ilość dostarczonego towaru (protokół przekazania). ZAMAWIAJĄCY w terminie do 5 dni roboczych od daty sporządzenia protokołu przekazania dokona sprawdzenia dostarczonego towaru pod kątem zgodności wykonanego zamówienia z Umową, w szczególności w zakresie kompletności i jakości dostarczonego towaru. ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia zgodności rodzaju dostarczonych artykułów z zamówieniem i fakturą (tj. nazwę producenta, nazwę artykułu, zamówioną ilość artykułu, dostarczoną ilość artykułu, zgodność otrzymanego artykułu z zamówionym oraz ewentualne uwagi np. dotyczące stanu opakowań itp.).

Postanowienia szczególne w zakresie dzierżawy

§ 4.

1. WYKONAWCA zapewnia, iż urządzenia do badań wraz z dodatkowym wyposażeniem są fabrycznie nowe i wolne od roszczeń osób trzecich (dotyczy aparatu dostarczonego jako „nowy” rok produkcji ... *(zależy od treści złożonej oferty)*).
2. WYKONAWCA przekaże w momencie dostawy gwarancję, dostarczenie wymaganej dokumentacji powdrożeniowej:
 - a. instrukcję użytkowania w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres: aparatura@onkologia.szczecin.pl
 - b. potwierdzenie zgłoszenia lub powiadomienia dotyczącego wyrobu, Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych. (Ustawa o wyrobach Medycznych z dnia 7.04.2022 r Dz.U.2024.1620 ze zm. lub rejestracji w bazie Eudamed, (art. 22 rozporządzenia 2017/745) prowadzonej przez Komisję Europejską przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy, na adres: aparatura@onkologia.szczecin.pl
 - c. Certyfikat CE dostarczony w formie elektronicznej przed podpisaniem umowy, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy na adres: aparatura@onkologia.szczecin.pl
 - d. dokona ustawienia i uruchomienia dostarczonych urządzeń, dokona podłączenia do systemu informatycznego Eskulap oraz przeprowadzi szkolenie personelu ZAMAWIAJĄCEGO, potwierdzonego protokołem ze szkolenia.
3. Po uruchomieniu i stwierdzeniu prawidłowości działania urządzeń, strony sporządzą protokół przekazania (**Załącznik nr 6 do umowy**), w którym szczegółowo określą jakość i elementy wyposażenia wszystkich urządzeń.
4. ZAMAWIAJĄCY odmówi podpisania protokołu przekazania, jeżeli urządzenia nie będą odpowiadały warunkom niniejszej umowy i specyfikacji technicznej.

§ 5.

1. Naprawy bieżące i konserwacja urządzeń należą do obowiązków WYKONAWCY, a ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do umożliwienia wykonania tych czynności przez WYKONAWCĘ.
2. WYKONAWCA uprawniony jest do oględzin i kontroli prawidłowości wykorzystywania urządzeń przez ZAMAWIAJĄCEGO oraz zabezpieczenia urządzeń.

§ 6.

1. WYKONAWCA w czasie trwania umowy i w ramach ceny umowy zobowiązany jest do:
 - 1) wykonywania wszelkich napraw wraz z dostawą fabrycznie nowych części zamiennych,
 - 2) wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi w dokumentacji technicznej wraz z materiałami eksploatacyjnymi.
2. WYKONAWCA w czasie trwania umowy zapewnia pomoc zdalną poprzez dostęp do linii serwisowej online przez 7 dni w tygodniu w godzinach funkcjonowania laboratorium.
3. W przypadku konieczności naprawy w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO czas reakcji - rozumiany jako przyjazd inżyniera serwisowego - wynosi do 24 godzin w dni robocze

licząc od chwili zgłoszenia, pod warunkiem, że w momencie wystąpienia awarii urządzenia drugi analizator znajdujący się na wyposażeniu ZAMAWIAJĄCEGO jest sprawny. W przypadku, gdy w chwili wystąpienia awarii drugi analizator jest niesprawny, czas reakcji wynosi do 24 godzin licząc w sposób ciągły (dni kalendarzowe). Naprawa powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 48 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia (niezależnie od tego czy dokonywana jest w sposób zdalny czy stacjonarny). W przypadku, gdy naprawa wymagać będzie czasu przekraczającego ten termin, WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach.

4. W przypadku, uszkodzenia dwóch urządzeń w jednym czasie WYKONAWCA ma obowiązek dostarczyć dwa urządzenia zastępcze o takich samych lub lepszych parametrach. W celu zachowania ciągłości badań na czas oczekiwania na urządzenia zastępcze, WYKONAWCA zapewni ZAMAWIAJĄCEMU jednostkę, która wykona badania zlecone przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt WYKONAWCY.
5. Wszelkie czynności serwisowe, przeglądy, naprawy kalibracje, aktualizacje oprogramowania itp., powinny być udokumentowane raportami serwisowymi i wpisami do paszportów urządzeń.

§ 7.

1. Odbiór zainstalowanych urządzeń nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron, w chwili sporządzania protokołu przekazania.
2. Po dokonaniu odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA przekazuje paszporty techniczne urządzeń, w których potwierdza prawidłowość montażu i sprawność wszystkich urządzeń.
3. Protokół przekazania będzie zaopatrzony w pisemne oświadczenie WYKONAWCY, iż przedmiot dzierżawy jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami współczesnej wiedzy, jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz został zamontowany w zgodzie z tymi warunkami.

§ 8.

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się korzystać z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób określony w instrukcji przekazanej przez WYKONAWCĘ, a ponadto:
 - 1) chronić urządzenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i przypadkową utratą,
 - 2) utrzymywać przedmiot dzierżawy w należytym stanie, stosując się do zaleceń WYKONAWCY w tym zakresie,
 - 3) używać do wykonywanych badań odczynników WYKONAWCY,
 - 4) zawiadamiać przy wykorzystaniu systemu zgłoszeniowego typu help desk WYKONAWCĘ o wadliwej pracy danego urządzenia.
2. Ryzyko przypadkowej utraty urządzenia, jego zniszczenie lub uszkodzenie obciąża ZAMAWIAJĄCEGO, z wyjątkiem przypadku, gdy zniszczenie lub uszkodzenie wynika z wady tkwiącej w urządzeniu.
3. ZAMAWIAJĄCY nie może bez zgody WYKONAWCY udostępniać urządzenia do używania osobom trzecim, ani ich poddzierżawiać, przy czym za osoby trzecie nie uważa się pracowników ZAMAWIAJĄCEGO zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej.

§ 9.

1. Po zakończeniu umowy ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY przedmiot dzierżawy w należytym stanie, wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji i naturalnego zużycia.
2. Koszty odbioru i transportu urządzeń z siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, obciążają WYKONAWCĘ.
3. Jeżeli przedmiot dzierżawy w chwili zwrotu przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie pogorszony w sposób rażący, w porównaniu ze stanem pierwotnym – WYKONAWCA ma prawo żądać dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO naprawy.

Postępowanie reklamacyjne w zakresie dostaw

§ 10.

1. WYKONAWCA odpowiada za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy oraz za brak zagwarantowanych właściwości.
2. WYKONAWCA udziela na dostarczone odczynniki (w tym surowice kontrolne, Kalibratory oraz inne niezbędne odczynniki i akcesoria) gwarancji jakości w wymiarze 12 miesięcy liczonych od daty dostawy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia WYKONAWCY i przesłania protokołu reklamacyjnego. Braki lub nadwyżki ilościowe ZAMAWIAJĄCY zgłosi przy odbiorze potwierdzając dokument WZ lub przesyłając WYKONAWCY protokół reklamacyjny.
4. WYKONAWCA rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zobowiązany jest do odbioru na swój koszt wadliwego przedmiotu umowy i a w razie zasadności reklamacji wystawienia zgodnie z przepisami faktury korygującej. Brak udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu **5 dni roboczych**, licząc od dnia jej zgłoszenia, uważa się za uznanie reklamacji.
5. W okresie gwarancji, w przypadku uznania reklamacji WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad **do 3 dni roboczych** liczonych od dnia uznania reklamacji przez WYKONAWCĘ.
6. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCY może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy przez i rzeczoznawcę z danej dziedziny.
7. Jeżeli reklamacja ZAMAWIAJĄCEGO okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy oraz koszty związane z usunięciem wad ponosi WYKONAWCA.
8. Przez dni robocze w rozumieniu umowy rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Kary umowne

§ 11.

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
 - 1) w przypadku zwłoki w dostawie odczynników (w tym surowic kontrolnych, Kalibratorów oraz innych niezbędnych odczynników i akcesoriów) o których mowa w **załączniku nr 5 do umowy**, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2% wartości netto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki, przy czym:

- a) jeżeli dostarczono co najmniej połowę zamówionej ilości – kara nie może być niższa niż 10 zł za każdy dzień zwłoki,
 - b) w pozostałych przypadkach – kara nie może być niższa niż 50 zł za każdy dzień zwłoki.”
 - 2) w wysokości 1% wartości netto reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki w jego wymianie, lub uzupełnieniu ilości lub uzupełnieniu brakującego towaru,
 - 3) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w montażu przedmiotu dzierżawy,
 - 4) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady/awarii przedmiotu dzierżawy,
 - 5) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zawinionych po stronie WYKONAWCY,
 - 6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 5% kwoty netto, której WYKONAWCA nie zapłacił lub z której zapłatą popadł w zwłokę za każdy przypadek.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez WYKONAWCĘ z przyczyn zawinionych po stronie ZAMAWIAJĄCEGO.
 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 4. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności przysługujących mu od ZAMAWIAJĄCEGO.
 5. Na okoliczność naliczonych kar umownych Strony wystawią noty obciążeniowe, które zawierać będą między innymi wskazanie przyczyny uzasadniającej naliczenie kary.
 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do sumowania kar umownych. Łączna wysokość kar umownych jakiej mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.

Odstąpienie od umowy

§ 12.

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w całości lub w części), w przypadku:
 - 1) zwłoki w dostawie, co najmniej dwóch zamówień z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
 - 2) co najmniej 3 – krotnego braku potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,
 - 3) dostarczania towaru niskiej jakości lub nieodpowiadającego obowiązującym normom i warunkom umownym,
 - 4) nieprzestrzegania terminów rozpatrzenia reklamacji i/lub wymiany reklamowanego produktu z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY,

- 5) odmowy WYKONAWCY zrealizowania zamówienia, z wyjątkiem zalegania przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatnościami za okres przekraczający 30 dni.
 - 6) naruszanie obowiązku terminowej naprawy urządzeń lub dokonywanie częstych napraw spowodowanych ich niską jakością,
 - 7) nie=dostarczenia i uruchomienia urządzeń w terminach wskazanych w § 2 ust. 1)-3) umowy,
 - 8) innych niż wskazane powyżej uchybień przy realizacji umowy po stronie WYKONAWCY, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu WYKONAWCY do należytego wykonywaniu umowy w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nie krótszym niż 7 dni.
3. WYKONAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia, w przypadku
- 1) zalegania przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatnościami ponad 60 dni,
 - 2) nie zapewnienia przez ZAMAWIAJĄCEGO należytego zabezpieczenia urządzeń, mimo pisemnych pouczeń,
 - 3) wykorzystywania urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub w sposób rażąco niezgodny z instrukcją użytkowania, powodujący liczne awarie.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sporządzane jest przez strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Ponadto ZAMAWIAJĄCEMY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach a nadto w innych okolicznościach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Prawie zamówień publicznych lub innych obowiązujących przepisach.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy każda ze Stron może złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, nie później jednak niż w terminie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przedstawiciele stron

§ 13.

1. Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO uprawnionymi do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy są:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...

2) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ:

1) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...

2) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...

INTEGRACJA DZIERŻAWIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z SYSTEMEM SZPITALNYM ESKULAP:

1) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...

2) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...

2. Przedstawicielami WYKONAWCY uprawnionymi do reprezentowania go we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy są:
 - 1) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...
 - 2) ..., e-mail: ..., nr tel.: ...
3. Zmiana osób wskazana w ustępach poprzedzających nie wymaga zmiany umowy, a dowodnego zawiadomienia drugiej strony.
4. Strony oświadczają, że adresy podane na wstępie Umowy, są adresami właściwymi do dokonywania skutecznych doręczeń. Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się o zmianie siedziby lub adresu do doręczeń. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku pismo wysłane listem poleconym na ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczone.

Zmiana umowy

§ 14.

1. ZAMAWIAJĄCY, dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian do umowy, które będą dla niego korzystne lub będą wynikały z jego możliwości płatniczych, względnie będą dokonane w interesie publicznym albo ważnym interesie ZAMAWIAJĄCEGO, oraz w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 8-15, a także zmian związanych ze zmianami stanu prawnego w trakcie obowiązywania umowy.
2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówień, o którym mowa w §2 ust. 8 Umowy, o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu dostawy w przypadku działania siły wyższej o ile mają one wpływ na termin dostawy przez WYKONAWCĘ. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności zdarzenie nagłe, zewnętrzne i niezależne od woli Stron takie jak: epidemie, wojny, klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, pożary, powódzie etc.
3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy wskazanego w §1 ust. 2 umowy w przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy (maksymalna wartości umowy). W takiej sytuacji ZAMAWIAJĄCY wydłuża termin obowiązywania umowy o czas niezbędny do wyczerpania wartości wskazanej w §2 ust. 1, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.
4. Zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksów, podpisanych przez obie strony.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany formalno-organizacyjne, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do odbioru i realizacji umowy między stronami.

§14¹.

1. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:
 - 1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub działań zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego albo na terytorium innego państwa graniczącego z Rzeczpospolitą Polską lub okupacji na tych terytoriach lub
 - 2) obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego albo stanu wojennego,

- 3) występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia w związku z występowaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego czy stanu epidemii.
 - Strony umowy dopuszczają zmianę umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jeśli powyższe okoliczności mają wpływ na należyte wykonanie umowy.
2. Strony umowy wzajemnie informują się o wpływie okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie umowy potwierdzając ten wpływ oświadczeniami lub dokumentami.
3. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1 na należyte wykonanie tej umowy.
4. ZAMAWIAJĄCY, po stwierdzeniu, że okoliczności, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy przez:
 - 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
 - 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, w tym zmianę terminu sukcesywnych dostaw,
 - 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,
 - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Obowiązek informacyjny wobec osób podpisujących umowę

§ 15.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, ZAMAWIAJĄCY przedkłada następującą informację dotyczącą danych osobowych osób działających w imieniu WYKONAWCY przy realizacji zamówienia:

- 1) administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ul. Strzałowska 22; 71-730 Szczecin,
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych u ZAMAWIAJĄCEGO jest Jacek Motylewski kontakt: adres e-mail iod@onkologia.szczecin.pl nr telefonu 91 42 51 410 wew. 621.
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes wskazuje się konieczność zawarcia umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia właściwej realizacji Umowy w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy,
- 5) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej lub będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji umowy,
- 6) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie zrealizowana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania z uwagi na obowiązki

archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń, obronę przed roszczeniami lub inne wymagania zawarte w obowiązujących przepisach prawa,

- 7) osoby podpisujące i realizujące umowę w imieniu WYKONAWCY mają prawo do:
 - a) żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących i sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych,
 - b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- 8) decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- 9) osobom działającym w imieniu WYKONAWCY nie przysługuje prawo:
 - a) do usunięcia danych osobowych,
 - b) do przenoszenia danych osobowych,
 - c) do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli i innych osób WYKONAWCY

§ 16.

1. Obowiązek informacyjny wobec przedstawicieli WYKONAWCY w zakresie wykonywania umowy oraz innych osób realizujących umowę w imieniu WYKONAWCY (w tym jego podwykonawcy) spoczywa na WYKONAWCY.
2. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia, że każda z osób, o których mowa w ust. 1 zapozna się dowodnie z treścią obowiązku informacyjnego odpowiadającego treści obowiązku informacyjnego, zawartego w paragrafie poprzedzającym.

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.
2. WYKONAWCA nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności - zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych z przepisami wykonawczymi, Ustawy o wyrobach medycznych, oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 18.

1. W przypadku zaistnienia spraw spornych strony będą dążyć do ich załatwienia polubownie, co nie stanowi zapisu na sąd polubowny.
2. W razie nie dojścia do porozumienia strony poddadzą spór przed sąd powszechny właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 19.

Umowa została sporządzona w formie elektronicznej oraz przekazana każdej ze Stron.

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

...

/dokument podpisany elektronicznie/

...

/dokument podpisany elektronicznie/

...

/dokument podpisany elektronicznie/

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:

Załącznik techniczny nr 1: Opis przedmiotu zamówienia w zakresie instalacji sieciowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis systemu biochemiczno – immunochemicznego

Załącznik nr 2: Szczegółowy opis systemu przedanalizycznego

Załącznik nr 3: Ocena parametrów systemu biochemiczno – immunochemicznego, odczynników biochemicznych i immunochemicznych

Załącznik nr 4: Rzut pomieszczeń ze wskazaniem lokalizacji 2 systemów biochemiczno – immunochemicznych i 2 stacji wody oraz sortera, instalacji prądowej i sieciowej

Załącznik nr 5: Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6: Protokół odbioru urządzenia medycznego

Załącznik nr 7: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 8: Polityka Bezpieczeństwa Informacji dla Wykonawców ZCO

PROTOKÓŁ ODBIORU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO

z dniar.

1. Podstawa realizacji zamówienia:

Umowa nr **PN-13/26**, z dnia r. z obowiązującym terminem dostawy
.....

2. Strony:

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin	
reprezentowani przez: (imię, nazwisko, stanowisko)	

3. Przedmiot dostawy:

lp.	wyszczególnienie (rodzaj, typ, model, podstawowe parametry techniczne)	ilość kpl./szt.	Rok prod.	numery fabryczne
1.				
2.				
...				

4. Informacje serwisowe

Informacje serwisowe	Podać	nie wymagana
okres gwarancji		<input type="checkbox"/>
ilość nieodpłatnych przeglądów w okresie gwarancji		<input type="checkbox"/>
częstotliwość przeglądów według zaleceń producenta		<input type="checkbox"/>
autoryzowane serwisy producenta – dane kontaktowe		<input type="checkbox"/>

5. Zgodność dostawy z zamówieniem:

<input type="checkbox"/> pełna zgodność
<input type="checkbox"/> braki ilościowe (opis w pkt. 6)
<input type="checkbox"/> braki jakościowe (opis w pkt. 6)

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizy.

- 6. Opis dostawy:** (zapakowany – rozpakowany, liczba sztuk, wymiary i sposób opisanie opakowań, dokumenty przekazane Zamawiającemu wraz z dostawą)

7. Pozostałe czynności:

rodzaj	wykonana w całości	wykonana częściowo, lub nie wykonana – brak zgodności z zamówieniem	zostanie wykonana do dnia	nie wymagana
demontaż innego urządzenia i dostarczenie do wyznaczonego miejsca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
roboty budowlane	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
montaż	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
testy i pomiary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
uruchomienie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
szkolenie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doręczenie instrukcji obsługi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
doręczenie paszportu techn.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
przed zawarciem umowy DOSTAWCA przedłożył: –specyfikacje techniczne/karty produktu/karty katalogowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DOSTAWCA przed podpisaniem umowy, dostarczył: - certyfikat CE i IVD wraz z dokumentami dopuszczającymi stosowanie urządzenia na terenie Polski w formie elektronicznej, – instrukcję obsługi w języku polskim w formie elektronicznej, – wykaz czynności jakie powinny być wykonane przez inżyniera serwisu podczas wykonywania okresowego przeglądu technicznego w formie elektronicznej (check-lista),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizy.

– wykaz podmiotów obsługi serwisowej – dokument, o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.,				
– wykaz części zamiennych wraz z numerami katalogowymi				

8. Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego:

<input type="checkbox"/> brak
<input type="checkbox"/> stwierdzono następujące niezgodności:

9. Załącznikiem do protokołu jest potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego:

<input type="checkbox"/> TAK
<input type="checkbox"/> NIE, czynność wskazana w pkt. 5 do wykonania w terminie późniejszym
<input type="checkbox"/> NIE, szkolenie nie było objęte umową

10. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury:

<input type="checkbox"/> TAK, bez zastrzeżeń
<input type="checkbox"/> TAK, z zastrzeżeniem wykonania czynności które wskazano w pkt. 5 do wykonania w terminie późniejszym
<input type="checkbox"/> TAK, z zastrzeżeniem usunięcia, w terminie zapłaty, niezgodności wskazanych w pkt. 6
<input type="checkbox"/> NIE, przedmiot zamówienia nie nadaje się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

11. Załączniki do protokołu:

l. p.	wyszczególnienie
1.	
2.	
...	

Podpisy:

**PROTOKÓŁ POTWIERDZAJĄCY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
ZCO Z OBSŁUGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Data szkolenia:
2. Nazwa firmy przeprowadzającej szkolenie:
3. Nazwa urządzenia medycznego:
4. Nr seryjny urządzenia medycznego:
5. Urządzenie dostarczone w ramach umowy nr: **PN-13/26**

LISTA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU

lp.	Imię i nazwisko, oddział, stanowisko	podpis

uwagi do przeprowadzonego szkolenia	
---	--

Podpisy osób wyznaczonych do reprezentowania stron przy odbiorze przedmiotu

**UMOWA powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zwana dalej Umową**

zawarta w Szczecinie, w dniu ... r. pomiędzy:

Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048836, posiadającym NIP 851-25-37-776, Regon 000817391, reprezentowanym przez:

1. ...
2. ...

zwanym dalej Zamawiającym,

a firmą ... z siedzibą w ... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ... pod nr KRS ..., będącą podatnikiem czynnym podatku VAT zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP ... reprezentowaną przez:

1. ...
2. ...

zwaną dalej Wykonawcą

Strony zawarły Umowę („Umowa Podstawowa”), w związku, z wykonywaniem której Zamawiający (Administrator) powierzy Wykonawcy (Podmiotowi przetwarzającemu) przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.

§ 1.

Definicje

- a) **Podmiot przetwarzający** – podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia z Zamawiającym i w jego imieniu, zwany także Wykonawcą.
- b) **Administrator** - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, zwany także Zamawiającym.
- c) **Zbiór danych** - każdy posiadający strukturę (uporządkowany) zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
- d) **Przetwarzanie danych** - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych lub zestawach osobowych w sposób zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, porządkowanie, adoptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

- e) **Rozporządzenie-** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- f) **Inny podmiot przetwarzający (podwykonawca)** - podmiot, któremu podmiot przetwarzający w imieniu administratora podpowierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych.

§ 2.

Przedmiot Umowy, cel, charakter i zakres

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Zamawiającego danych osobowych do przetwarzania przez Wykonawcę.
2. Cele powierzenia przetwarzania definiuje umowa podstawowa.
3. Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
4. Zakres danych powierzonych do przetwarzania obejmuje:
 - a. dane pacjentów – ogólne:
 - nazwisko i imię,
 - pesel,
 - nr telefonu,
 - dane teleadresowe;
 - b. dane pacjentów – szczególne:
 - dane medyczne (rozpoznanie, wyniki badań, itp.);
 - c. dane pracowników – ogólne:
 - nazwisko i imię,
 - stanowisko,
 - nr tel. kontaktowego,
 - adres email,
 - NPW (w przypadku pracowników medycznych).

§ 3.

Czas trwania

1. Podmiot przetwarzający uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy podstawowej.
2. W terminie 14 dni od ustania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych, ze wszystkich nośników, programów i aplikacji w tym również kopii, chyba, że obowiązek ich dalszego przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa.

§ 4.

Obowiązki i prawa

1. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w zakresie udzielania odpowiedzi na żądania osoby, której dane dotyczą, opisane w rozdziale III Rozporządzenia (w szczególności informowanie i przejrzysta komunikacja, dostęp do danych, obowiązek informacyjny, prawo dostępu, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, zautomatyzowane podejmowanie decyzji).
2. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy Zamawiającemu w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia (w szczególności dla bezpieczeństwa przetwarzania, zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, konsultacji z organem nadzorczym).
3. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Wykonawcy oraz umożliwi Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych.

§ 5.

Zgłaszanie incydentów

1. Wykonawca zobowiązuje się, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, do zgłoszenia tego Zamawiającemu, w terminie 36 godzin od chwili ujawnienia tego faktu.
2. Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:
 - a. opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie dotyczy,
 - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
3. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 2 Wykonawca przekazuje niezbędną dokumentację naruszenia ochrony danych osobowych, celem powiadomienia organów nadzoru przez Zamawiającego.

§ 6.

Korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego

1. Wykonawca nie może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego (podwykonawcy) bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku ogólnej pisemnej zgody Wykonawca informuje Zamawiającego o wszelkich zamierzonych zmianach, dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Zamawiającemu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 14 dni.

3. Podpowierzenie przetwarzania przez Wykonawcę podmiotowi przetwarzającemu wymaga formy pisemnej. W przypadku podpowierzenia, na podwykonawcę zostaną nałożone takie same obowiązki, jak wynikają z niniejszej Umowy.
4. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy tak, jak za własne.
5. Lista zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy powierzenia
6. Zamawiający dopuści możliwość podpowierzenia przetwarzania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) spółkom powiązanym i podwykonawcom Wykonawcy pod warunkiem, że istnieje decyzja adekwatności w odniesieniu do danego państwa trzeciego lub organizacji zgodnie z art.45 RODO lub Wykonawca przedstawi wykorzystane standardowe klauzule umowne (SCC) wsparte dodatkowymi środkami uzupełniającymi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu ocenę skutku transferu (TIA) wskazującą, że transfer danych poza EOG nie obniży poziomu ochrony danych osobowych wynikający z RODO.

§ 7.

Deklarowane środki techniczne i organizacyjne

1. Wykonawca gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych.
2. Wykonawca deklaruje stosowanie środków technicznych i organizacyjnych określonych w art. 32 Rozporządzenia, jako adekwatnych do zidentyfikowanego ryzyka naruszenia praw lub wolności powierzonych danych osobowych a w szczególności:
 - a. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 - b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 - c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 - d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
3. Wykonawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§ 8.

Kontrola i nadzór

1. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu kontrolowanie Wykonawcy i innego podmiotu przetwarzającego, w tym pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu danych osobowych, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń danych osobowych oraz realizacji obowiązków stąd wynikających, a także w zakresie oceny prawidłowości

przetwarzania danych osobowych udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub usługi.

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z wyników przeprowadzonej kontroli.
3. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia ZAMAWIAJĄCEMU danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów WYKONAWCY, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez WYKONAWCĘ środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa WYKONAWCY. Czynności kontrolne odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez WYKONAWCĘ. Czynności kontrolne nie mogą utrudniać działalności WYKONAWCY, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników WYKONAWCY.

§ 9.

Odpowiedzialność

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym ich właściwą ochronę, przez wszystkie osoby, które realizują wykonanie niniejszej Umowy oraz przez inny podmiot przetwarzający i ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub wynikającymi z obowiązujących przepisów.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a w szczególności w związku z ich bezprawnym udostępnieniem.

§ 10.

Rozwiązanie umowy

Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca:

- 1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
- 2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
- 3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Umowa zastępuje wszelkie inne ustalenia dokonane pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przetwarzania danych osobowych bez względu na to, czy zostały uregulowane umową czy innym instrumentem prawnym.
2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Rozporządzenia.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY. *(wersja papierowa)*

Polityka Bezpieczeństwa Informacji dla Wykonawców ZCO

I. Zasady ogólne.

1. Niniejsza Polityka jest częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, określającą obowiązki i odpowiedzialności Wykonawców działających na rzecz Zamawiającego w zakresie ochrony informacji oraz definiuje zasady współpracy stron w tym zakresie.
2. Celem niniejszej Polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych u Zamawiającego niezależnie od ich formy, rodzaju i sposobu utrwalenia, w związku z zawartą **Umową PN-13/26**, zwaną dalej Umową Podstawową.
3. Za informację chronioną strony uznają taką informację, której utrata, ujawnienie lub udostępnienie osobie/podmiotowi nieuprawnionemu mogłoby spowodować szkodę materialną lub niematerialną dla Zamawiającego lub naruszyć prawnie chroniony interes innych osób/podmiotów będących w relacji z Zamawiającym. Są to w szczególności wszelkie informacje, dokumenty lub dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy oraz wytworzone przez Wykonawcę na potrzeby realizacji Umowy.
4. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują wszystkich Wykonawców oraz działających w jego imieniu podwykonawców uzyskujących dostęp do zasobów informacyjnych Zamawiającego. Mają one również zastosowanie także do osób realizujących całość lub część zobowiązań umownych poza siedzibą Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy strony podpisały umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, jej zapisy mają charakter komplementarny w stosunku do postanowień niniejszej Polityki.
6. Ze stosowania niniejszej Polityki wyłączone są informacje niejawne oraz systemy ich przetwarzania w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm.).
7. Jako informację nie podlegającą szczególnej ochronie strony uznają wszelkie informacje o charakterze publicznym, zdefiniowane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022r., poz. 902 ze zm.).

II. Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu przez Zamawiającego informacje tylko przez okres obowiązywania Umowy Podstawowej i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w Umowie Podstawowej.
2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności wszystkich informacji mających wpływ na ich bezpieczeństwo, niezależnie od sposobu ich pozyskania, zarówno w trakcie trwania Umowy Podstawowej, jak i po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub zakończeniu jej trwania w inny sposób.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wszelkich niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania informacji, w szczególności, powinien zabezpieczyć informacje przed ich udostępnieniem

osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem postanowień Umowy, zmianą, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

4. Pracownicy i osoby trzecie realizujące prace na rzecz ZCO w imieniu Wykonawcy są zobowiązane do:
 - a. zapoznania się z postanowieniami niniejszej Polityki,
 - b. przetwarzania informacji w sposób i w zakresie, który wynika z umowy podstawowej, zapewniając ich integralność, poufność i dostępność,
 - c. poruszania się jedynie pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego w miejscach ogólnie niedostępnych (o ile ustalenia umowne nie stanowią inaczej),
 - d. zadbania o odpowiednie zabezpieczenie fizyczne i informatyczne stanowisk pracy w przypadku świadczenia usług na odległość,
 - e. niezwłocznego zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji do Inspektora Ochrony Danych,
 - f. wykonywania wszelkich prac na terenie ZCO z poszanowaniem praw pacjenta oraz niezakłócaniem komfortu pracujących osób.
5. Pracownicy i osoby trzecie realizujące prace na rzecz ZCO w imieniu Wykonawcy są zobowiązane do zaakceptowania faktu podglądu ich pracy za pomocą urządzeń wizyjnych (kamery na terenie ZCO) oraz monitoringu ich pracy w sieci wewnętrznej Zamawiającego w przypadku świadczenia usług na odległość.
6. Osoby, które realizują Umowę w imieniu Wykonawcy zobowiązane są, przed przystąpieniem do prac, do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności informacji, którego wzór stanowi **Załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Wykonawców ZCO**.

III. Zasady współpracy

1. Strony ustalają, że bieżąca komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie odbywać się na drodze mailowej. W przypadku przesyłania informacji chronionych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji będzie stosować się zabezpieczenia kryptograficzne w postaci zaszyfrowania plików hasłem ustalonym na etapie realizacji przedmiotu umowy, o długości min.14 znaków.
2. Przed uzyskaniem dostępu do zasobów informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników i osób trzecich realizujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, w zakresie postanowień niniejszej Polityki oraz obowiązujących aktów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia.
3. Na żądanie Wykonawcy Zamawiający udzieli informacji w zakresie:
 - a. obowiązujących przepisów prawnych;
 - b. zagrożeń występujących na terenie Zamawiającego, związanych z realizacją zamówienia oraz zasad postępowania w sytuacjach wystąpienia tych zagrożeń.
4. Lista osób delegowanych do wykonania przedmiotu Umowy Podstawowej wraz z oświadczeniami (załącznik do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa Informacji) jest przekazywana osobie wyznaczonej do kontaktu po stronie Zamawiającego w celu nadania odpowiednich upoważnień. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego w przypadku modyfikacji listy osób wykonujących prace w imieniu Wykonawcy. Brak poinformowania Zamawiającego o zakończeniu współpracy z osobą wykonującą prace w imieniu Wykonawcy przenosi wszelką odpowiedzialność za aktywność takiej osoby na Wykonawcę.

5. Jeżeli elementy umowy obejmują urządzenia, które muszą być podłączone do sieci ZCO (np. komputery, sprzęt medyczny, sprzęt techniczny), a umowa nie przewiduje innych ustaleń, to wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wdrożeniem listę tych urządzeń oraz systemów. Lista ta powinna zawierać takie informacje jak:
 - a. nazwa urządzenia/systemu,
 - b. zakres i opis licencji,
 - c. producent,
 - d. opis i przeznaczenie,
 - e. MAC każdego interfejsu sieciowego.
6. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszystkie systemy podłączane do sieci ZCO muszą być zarządzane przez ActiveDirectory, współpracować z posiadanym aktualnie system antywirusowym oraz systemami kontroli dostępu na styku sieci lokalnej i internetu.
7. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy w pomieszczeniach, które nie są ogólnie dostępne, mogą odbywać się tylko pod nadzorem Zamawiającego, chyba że Umowa Podstawowa stanowi inaczej.
8. W ramach procedur odbiorczych Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej dotyczącej zrealizowanych dostaw lub usług. Dokumentacja ta powinna obejmować szczegółowe procedury bezpieczeństwa odnoszące się do zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń, systemów IT lub systemów medycznych, funkcjonujących, podłączonych do sieci ZCO. O ile to dotyczy, dokumentacja powinna zawierać m.in.:
 - a. zasady oraz częstotliwość aktualizacji oprogramowania i firmware urządzeń,
 - b. politykę tworzenia i przechowywania kopii zapasowych,
 - c. procedury przywracania działania po awarii.
9. Świadczenia usług poza godzinami pracy lub bez nadzoru Zamawiającego, mogą odbywać się tylko w szczególnych przypadkach, które określa Umowa Podstawowa

IV. Zasady świadczenia usług na odległość za pośrednictwem sieci Internet

1. Dostęp do środowiska teleinformatycznego następuje na podstawie imiennych upoważnień przekazanych przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale III.
2. Połączenia z siecią wewnętrzną odbywają się tylko poprzez kanały komunikacyjne VPN Zamawiającego.
3. Konfiguracje połączeń z infrastrukturą IT Zamawiającego, metody i środki uwierzytelnień oraz ewentualne certyfikaty dostępu Zamawiający przekaże na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zabronione jest bez uzgodnienia z Działem Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji ustanowienie innej, niezależnej komunikacji (jak np. TeamViewer, RDP) z urządzeniami infrastruktury Zamawiającego.
5. Do środowiska teleinformatycznego Zamawiającego mogą być podłączane wyłącznie komputery i urządzenia spełniające minimalne wymagania bezpieczeństwa. W szczególności wymagane jest spełnienie następujących warunków:
 - a. system operacyjny posiada zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje zabezpieczeń,

- b. wprowadzono zabezpieczenie dostępu silnym hasłem do zasobów komputera,
 - c. zainstalowano oprogramowanie szyfrujące zawartość dysków twardych,
 - d. system antywirusowy jest zainstalowany w systemie operacyjnym, a jego sygnatury są aktualne,
 - e. firewall jest uruchomiony w systemie operacyjnym i posiada właściwą konfigurację, odpowiadającą wykonywanym obowiązkom pracowniczym przez Użytkowników komputera,
 - f. zainstalowane na komputerze oprogramowanie pochodzi z zaufanych źródeł,
 - g. oprogramowanie jest zainstalowane zgodnie z postanowieniami licencji producenta oprogramowania.
6. Urządzenia Wykonawcy, o których mowa wyżej muszą być chronione w sposób uniemożliwiający bezpośrednie lub pośrednie pozyskanie przez osoby nieupoważnione dostępu do środowiska teleinformatycznego. Wykonawca w szczególności ma obowiązek wyeliminować możliwość przejęcia kontroli nad tymi urządzeniami lub ich wykorzystania w trakcie komunikacji.
7. Zabrania się podejmowania prób sprawdzania, testowania i omijania zabezpieczeń systemów informatycznych Zamawiającego.
8. Zabrania się używania jakichkolwiek nośników danych oraz korzystania z tzw. rozwiązań chmurowych (jak np. Dropbox, OneDrive itp.) bez stosownych uzgodnień z pracownikami Działu Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych.
9. Zamawiający ma prawo do ciągłego monitorowania wszelkiej aktywności sieciowej przedstawicieli Wykonawcy podczas pracy w systemach Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pełnej kontroli bezpieczeństwa udostępnionych przez Zamawiającego, jak i będących własnością Wykonawcy urządzeń, z których realizowany jest dostęp do środowiska teleinformatycznego Zamawiającego.

V. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa informacji

- 1. Wykonawca zobowiązuje się, po stwierdzeniu naruszenia bezpieczeństwa informacji, do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu tj. w czasie 24 godzin od momentu powzięcia przez Wykonawcę informacji o naruszeniu, umożliwiając jak najszybszą likwidację możliwych skutków naruszenia.
- 2. Wszelkie incydenty bezpieczeństwa Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do IOD lub osobie wyznaczonej do kontaktu po stronie Zamawiającego.
- 3. Informacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać co najmniej:
 - a. opis charakteru naruszenia (dostępność, integralność, poufność informacji),
 - b. opis możliwych konsekwencji naruszenia,
 - c. opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków.
- 4. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany
- 5. jest zabezpieczyć wszelką dokumentację związaną z naruszeniem celem powiadomienia organów nadzoru przez Zamawiającego (np. CSIRT NASK).
- 6. Wykonawca zobowiązuje się również do bezzwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o ewentualnych stwierdzonych podatnościach bezpieczeństwa w systemach IT Zamawiającego.

VI. Kontrola i nadzór

1. Zamawiający posiada prawo do kontroli, audytów i weryfikacji działań Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu kontrolowanie Wykonawcy lub innego podmiotu - podwykonawcy, w tym pomieszczeń i sprzętu używanego przy przetwarzaniu informacji, w zakresie niezbędnym do stwierdzenia prawidłowości stosowanych zabezpieczeń oraz realizacji obowiązków umownych, a także w zakresie oceny prawidłowości przetwarzania informacji udostępnionych dla realizacji określonego zadania lub usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do zaleceń Zamawiającego, dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania informacji oraz sposobów jej przetwarzania, wynikających z wyników przeprowadzonej kontroli.

VII. Odpowiedzialność

1. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy podstawowej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoich pracowników (lub współpracowników i podwykonawców) w zasobach informacyjnych Zamawiającego oraz za wszelkie szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Wykonawcę z systemów lub zasobów informacyjnych Zamawiającego.
2. Bez uszczerbku dla postanowień Umowy podstawowej, w sytuacji korzystania przez Wykonawcę przy realizacji Umowy podstawowej z usług podwykonawców, Wykonawca zapewnia przestrzeganie przez te podmioty oraz osoby realizujące w ich imieniu Umowę podstawową, wszystkich wymagań bezpieczeństwa Zamawiającego, o których mowa w niniejszej Polityce i ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego.
3. Naruszenie postanowień niniejszej Polityki przez Wykonawcę może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Podstawowej.
4. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji, niezależnie od odstąpienia od Umowy Podstawowej, Zamawiający może zażądać pokrycia powstałej szkody (do pełnej jej wysokości na zasadach ogólnych) lub zapłaty kary umownej, jeżeli taki obowiązek wynika z Umowy Podstawowej.
5. Brak dostępu do systemów lub zasobów teleinformatycznych Zamawiającego po stronie Wykonawcy, nie może być podstawą do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń.

Oświadczenie o zachowaniu poufności

W związku z wykonywaniem postanowień Umowy nr **PN-13/26** (zwanej dalej: Umową Podstawową), ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Wykonawców w ZCO i zobowiązuję się do:

1. zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących zasobów informacyjnych Zamawiającego oraz danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
2. podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, aby informacje poufne, wrażliwe i stanowiące tajemnicę organizacji nie zostały ujawnione w zakresie treści ani ich źródła, zarówno w całości, jaki i w części osobom trzecim (nieupoważnionym) bez uzyskania uprzednio wyrażonej przez Zamawiającego pisemnej zgody, której zakres lub źródło informacji dotyczy;

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizacyjnego.

3. nieujawniania sposobów zabezpieczeń stosowanych u Zamawiającego w trakcie wykonywania prac w związku z zawartą Umową Podstawową, jak i po ich zakończeniu;
4. zobowiązuje się nie wykraczać poza nadane mi uprawnienia oraz zobowiązuje się wykorzystywać przydzielone mi środki pracy, w tym systemy i urządzenia informatyczne, tylko do celów realizacji ww. umowy;
5. zobowiązuje się niezwłocznie zgłaszać przedstawicielowi Zamawiającego stwierdzone incydenty bezpieczeństwa informacji oraz ewentualne, odkryte podatności systemów informatycznych Zamawiającego.

Oświadczam, że znana jest mi treść niżej wymienionych przepisów w zakresie ochrony informacji oraz odpowiedzialności za jej ujawnienie:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
2. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.).

PN-13/26 FORMULARZ OFERTOWY

I. Oznaczenie WYKONAWCY składającego ofertę.

nazwa WYKONAWCY	
adres	
e-mail, telefon	
NIP	
REGON	
KRS	

II. Oferta WYKONAWCY.

KRYTERIUM NR 1 – CENA	
wartość netto (zł) <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>	wartość brutto (zł) <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>
wartość netto (zł) dostawa odczynników <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>	wartość brutto (zł) dostawa odczynników <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>
wartość netto (zł) dzierżawa przedmiotu zamówienia <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>	wartość brutto (zł) dzierżawa przedmiotu zamówienia <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>
KRYTERIUM NR 2 – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (dotyczy dostaw odczynników) <i>(wypełnia WYKONAWCA)</i>	
<input type="checkbox"/> termin realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych: 10 pkt	
<input type="checkbox"/> termin realizacji zamówienia: do 3 dni roboczych: 5 pkt	
<input type="checkbox"/> termin realizacji zamówienia: do 4 dni roboczych: 0 pkt	
Ocena KRYTERIUM NR 3, 4, 5 dokonana będzie na podstawie złożonego wraz z ofertą Załącznika nr 3 do SWZ	

VI. Oświadczenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizy.

oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu¹.

_____ dnia _____ 2026 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

¹ w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 4 (usunięcie treści oświadczenia następuje przez jego wykreślenie).

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy
o braku innych podstaw wykluczenia

*(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa
każdy z WYKONAWCÓW, oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:

.....
niniejszym oświadczam, że WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie przesłanek określonych w:

- 1) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wraz z jego dalszymi zmianami.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji WYKONAWCA nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wraz z jego dalszymi zmianami.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizy.

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 wraz z jego dalszymi zmianami..

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia ZAMAWIAJĄCEGO w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____ dnia _____ 2026 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

Przetarg nieograniczony nr PN-13/26
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów
biochemiczno-immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego.

Załącznik nr 8a
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Oświadczenie WYKONAWCY

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: **Dostawę odczynników wraz z dzierżawą dwóch zintegrowanych systemów biochemiczno - immunochemicznych oraz automatycznego systemu przedanalizycznego** oświadczam, że zaoferowany przedmiot dostawy i dzierżawy jest zgodny z zapisami zawartymi w **Załączniku nr 1, nr 2, nr 3 do SWZ.**

_____ dnia _____ 2026 r.

podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY

Załącznik nr 9
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

**Oświadczenie WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ)**

*(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW,
oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)*

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz :

.....
(pełna nazwa WYKONAWCY)

.....
(adres siedziby WYKONAWCY)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia *(należy wpisać nazwę zamówienia)* oświadczam, że informacje zawarte w złożonym przez nas oświadczeniu - JEDZ, w zakresie niżej wymienionych podstaw wykluczenia wskazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO są aktualne tj.:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczący orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, dotycząc zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.

_____ dnia _____ 2026 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

Załącznik nr 10
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

Oświadczenie WYKONAWCY, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z WYKONAWCÓW, oświadczenie powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Ja (My), niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa WYKONAWCY)

.....
(adres siedziby WYKONAWCY)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia *(należy wpisać nazwę zamówienia)* oświadczam, co następuje:

- ☐ **nie należę**
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714) co WYKONAWCY, którzy również złożyli oferty w powyższym postępowaniu.
- ☐ **należę do tej samej grupy kapitałowej**
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), co WYKONAWCA/Y *(nazwa i adres)*, który/rzy również złożył/li ofertę we wskazanym powyżej postępowaniu.

Jednocześnie wykazuję, iż złożona oferta została przygotowana niezależnie od oferty wskazanego powyżej WYKONAWCY: *(wypełnić)*

* zaznaczyć właściwy kwadrat lub niewłaściwe skreślić

_____ dnia _____ 2026 r.

podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY

Załącznik nr 11
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

NALEŻY ZŁOŻYĆ ZAŁĄCZNIK PRZED PODPISANIEM UMOWY

**Oświadczenie WYKONAWCY o aktualności informacji zawartych
w dodatkowym oświadczeniu złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 Ustawy
w zakresie innych podstaw wykluczenia**

Oświadczam, że aktualna pozostaje informacja zawarta w oświadczeniu JEDZ w zakresie braku zachodzenia podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514.).

Oświadczam, że aktualna pozostaje informacja zawarta w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) wraz z jego dalszymi zmianami.

_____ dnia _____ 2026 r.

*podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY*

Załącznik nr 12
do Specyfikacji Warunków Zamówienia
nr PN-13/26

NALEŻY ZŁOŻYĆ ZAŁĄCZNIK PRZED PODPISANIEM UMOWY

ANKIETA DOSTAWCY

(osobny plik)